

**FECHA:** 31/01/2024

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

**\*Nombre del lugar:** Hosp Doct. Alejo Martínez

**Área:** MANTENIMIENTO

**Nombre de la Actividad:** Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo 2024

**Código POA (Si aplica):**

### INTRODUCCIÓN

El mantenimiento se define como la preservación o conservación de una edificación y su contenido, para que sirva a su propósito establecido. Algunos autores lo definen como el “conjunto de actividades desarrolladas con el fin de conservar las propiedades (inmuebles, equipos, instalaciones, herramientas), en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido”.

### OBJETIVO DEL INFORME

Garantizar la operación confiable y sostenible de los activos fijos, maximizando su rendimiento y optimizando los costos a lo largo de su ciclo de vida, mediante la implementación de las mejores practicas de mantenimiento en la industria.

### METODOLOGIA (Si aplica)

El mantenimiento se realiza con la programación de la matriz de mantenimiento correctivo y preventivo que fue programa para el año completo, también cuenta con la matriz de seguimiento mensual para identificar los que hemos realizado correspondiente al mes que se está trabajando. Esta matriz permite que podamos realizar los que está programado para mantenimiento preventivo y correctivo.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

- . Detalles del mantenimiento efectuado: chequeo correctivo y preventivo, limpieza de aire acondicionado.
- 1- chequeo preventivo. Aire acondicionado odontología- limpieza de filtró chequeo eléctrico, ventilador, compresor y puesto en marcha.
  - 2- chequeo preventivo. Aire acondicionado sonógrafo - limpieza de filtró chequeo eléctrico, ventilador, compresor y puesto en marcha.
  - 3- chequeo preventivo. Aire acondicionado archivo- limpieza de filtró chequeo eléctrico, ventilador, compresor y puesto en marcha.
  - 4- chequeo preventivo. Aire acondicionado OFICINA adm- limpieza de filtró chequeo eléctrico, ventilador, compresor y puesto en marcha.
  - 5 -chequeo preventivo. Aire acondicionado laboratorio- limpieza de filtró chequeo eléctrico ventilador, compresor y puesto en marcha.
  - 6- chequeo preventivo. Aire acondicionado sala de espera emergencia- limpieza de filtró chequeo eléctrico,





ventilador, compresor y puesto en marcha.

7- chequeo preventivo. Aire acondicionado sala STO- de enfermería emergencia- limpieza de filtró chequeo eléctrico, ventilador, compresor y puesto en marcha.

7-chequeo preventivo. Aire acondicionado sala de cirugía- limpieza de filtró chequeo eléctrico, ventilador, compresor y puesto en marcha.

### RESULTADOS / CONCLUSIONES

Hemos logrado mejorar el servicios de mantenimiento con la matriz de seguimiento y los que se a programado se pudo identificar al gun problema en el proceso de chequeo preventivo, esto ayuda a que los equipos no se dañen por completo y se pueda resolver a tiempo la problemática o fallas a futuro.

### RECOMENDACIONES

Continuar con el chequeo preventivo de los equipos, para tener un mejor funcionamiento y mejor utilidad y servicios de la unidad que fue trabajada.

### ANEXOS (Si aplica)

Como evidencia podemos mostrar foto de la revisión que se le realizo al equipo de servicios en el informe general de mantenimiento

#### Instrucciones de llenado:

\*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Elaborado por  
(Nombre y Apellido)  
Dr. Alejo Martinez Garcia  
Administración  
RAMON SANTANA R.D.



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Registro de Equipos**  
DLC-FO-014- Versión: 01  
Fecha de aprobación: 26/07/2021

<b>Informaciones Generales</b>	
Nombre del establecimiento de salud: Hosp. Dr. Alejo Martínez García. R-S	Fecha: 31/01/2024
Regional de salud: V	Provincia: S-P-M
Nombre del responsable: MIGUEL A. RIVERA S.	
Cargo: A-D-M	Área: General.
<b>Informaciones del Equipo</b>	
Nombre del equipo:	Tipo o modelo:
Nombre del fabricante:	Núm. de serial:
Fecha de recepción del equipo:	Fecha de puesta en servicio: 31/01/2024
Estado en el momento de recepción: <input type="checkbox"/> Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input type="checkbox"/> Reacondicionado	
<b>Detalles del mantenimiento efectuado: chequeo correctivo y preventivo, limpieza de aire acondicionado.</b> 1- chequeo preventivo. Aire acondicionado odontología- limpieza de filtró chequeo eléctrico, ventilador, compresor y puesto en marcha. 2- chequeo preventivo. Aire acondicionado sonógrafo - limpieza de filtró chequeo eléctrico, ventilador, compresor y puesto en marcha. 3- chequeo preventivo. Aire acondicionado archivo- limpieza de filtró chequeo eléctrico, ventilador, compresor y puesto en marcha. 4- chequeo preventivo. Aire acondicionado OFICINA adm- limpieza de filtró chequeo eléctrico, ventilador, compresor y puesto en marcha.	
<b>Detalles del mantenimiento a futuro: continuar con el chequeo preventivo para programar los mantenimiento correctivo a futuro para lograr un mejor funcionamiento del equipo y tener mejo utilidad.</b>	
<b>Nota. El Aire acondicionado de archivo- se programó un mantenimiento correctivo para el mes de febrero 2024, se pudo ver un problema en el compresor o el sistema eléctrico.</b>	
<b>Historia de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o reparación:</b>	






Pedro Santana

Firma del responsable



Historia de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o reparación:

Pedro Santana  
*Pedro Santana*  
Firma del responsable

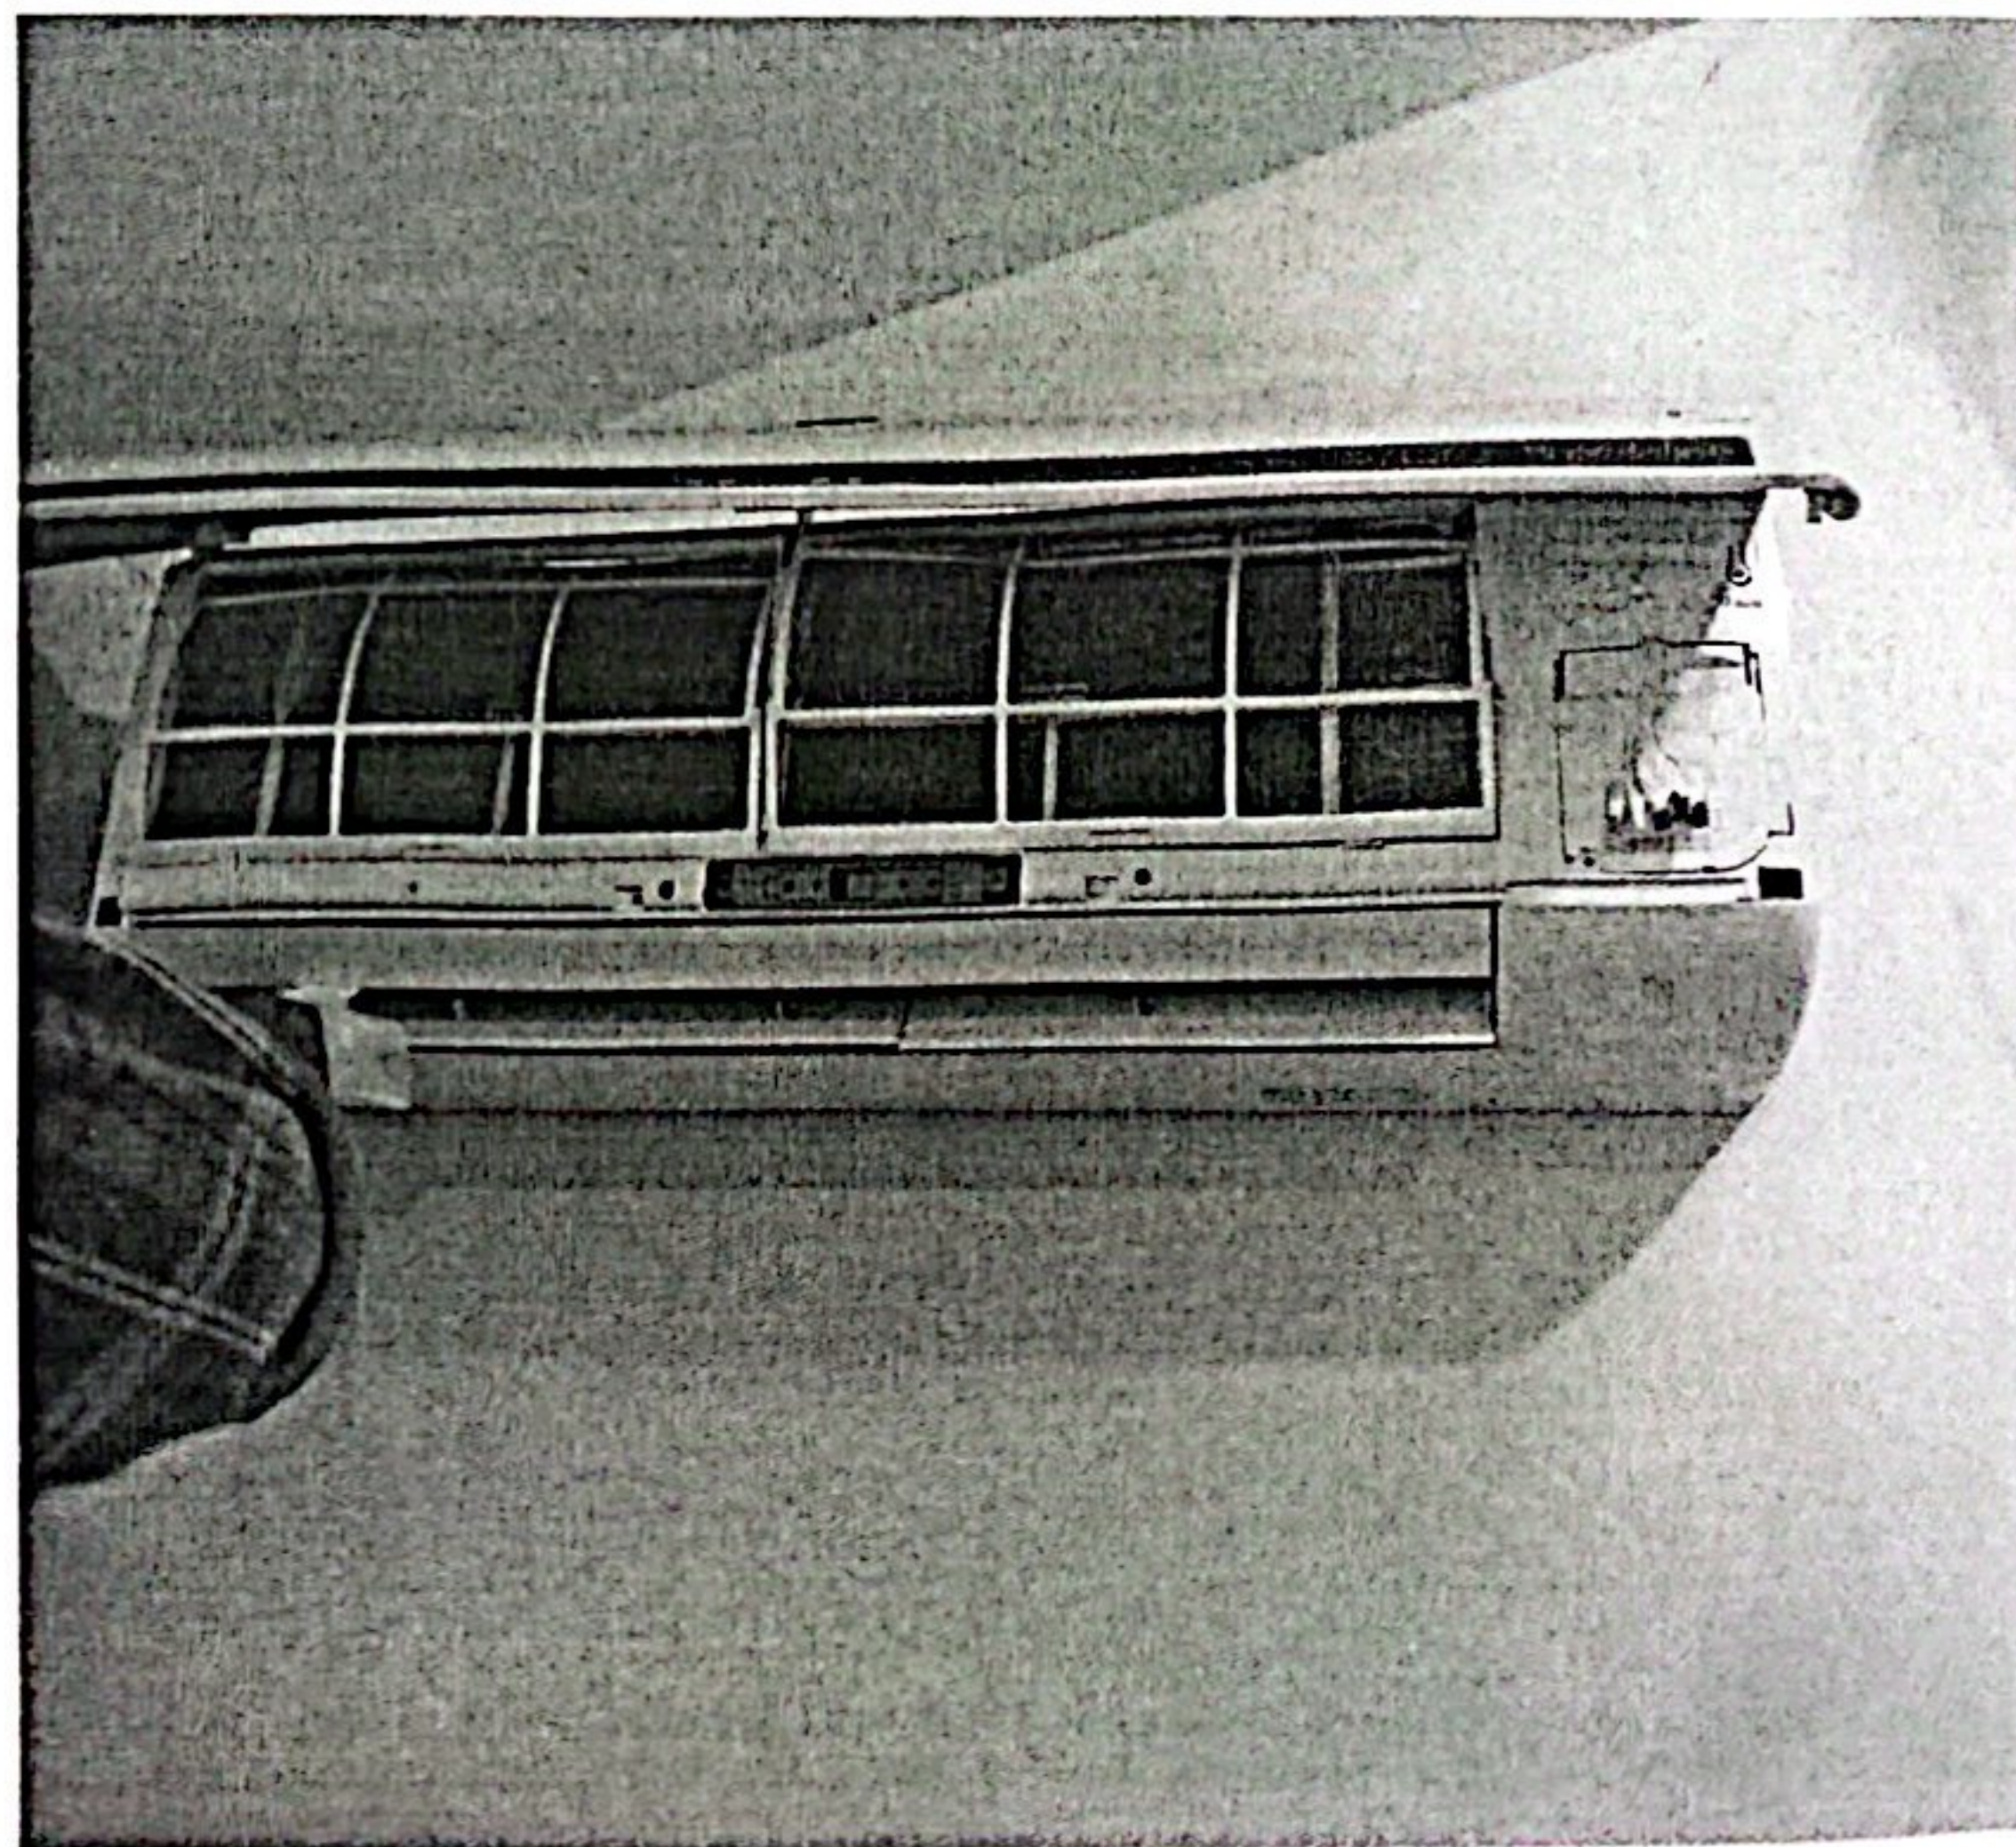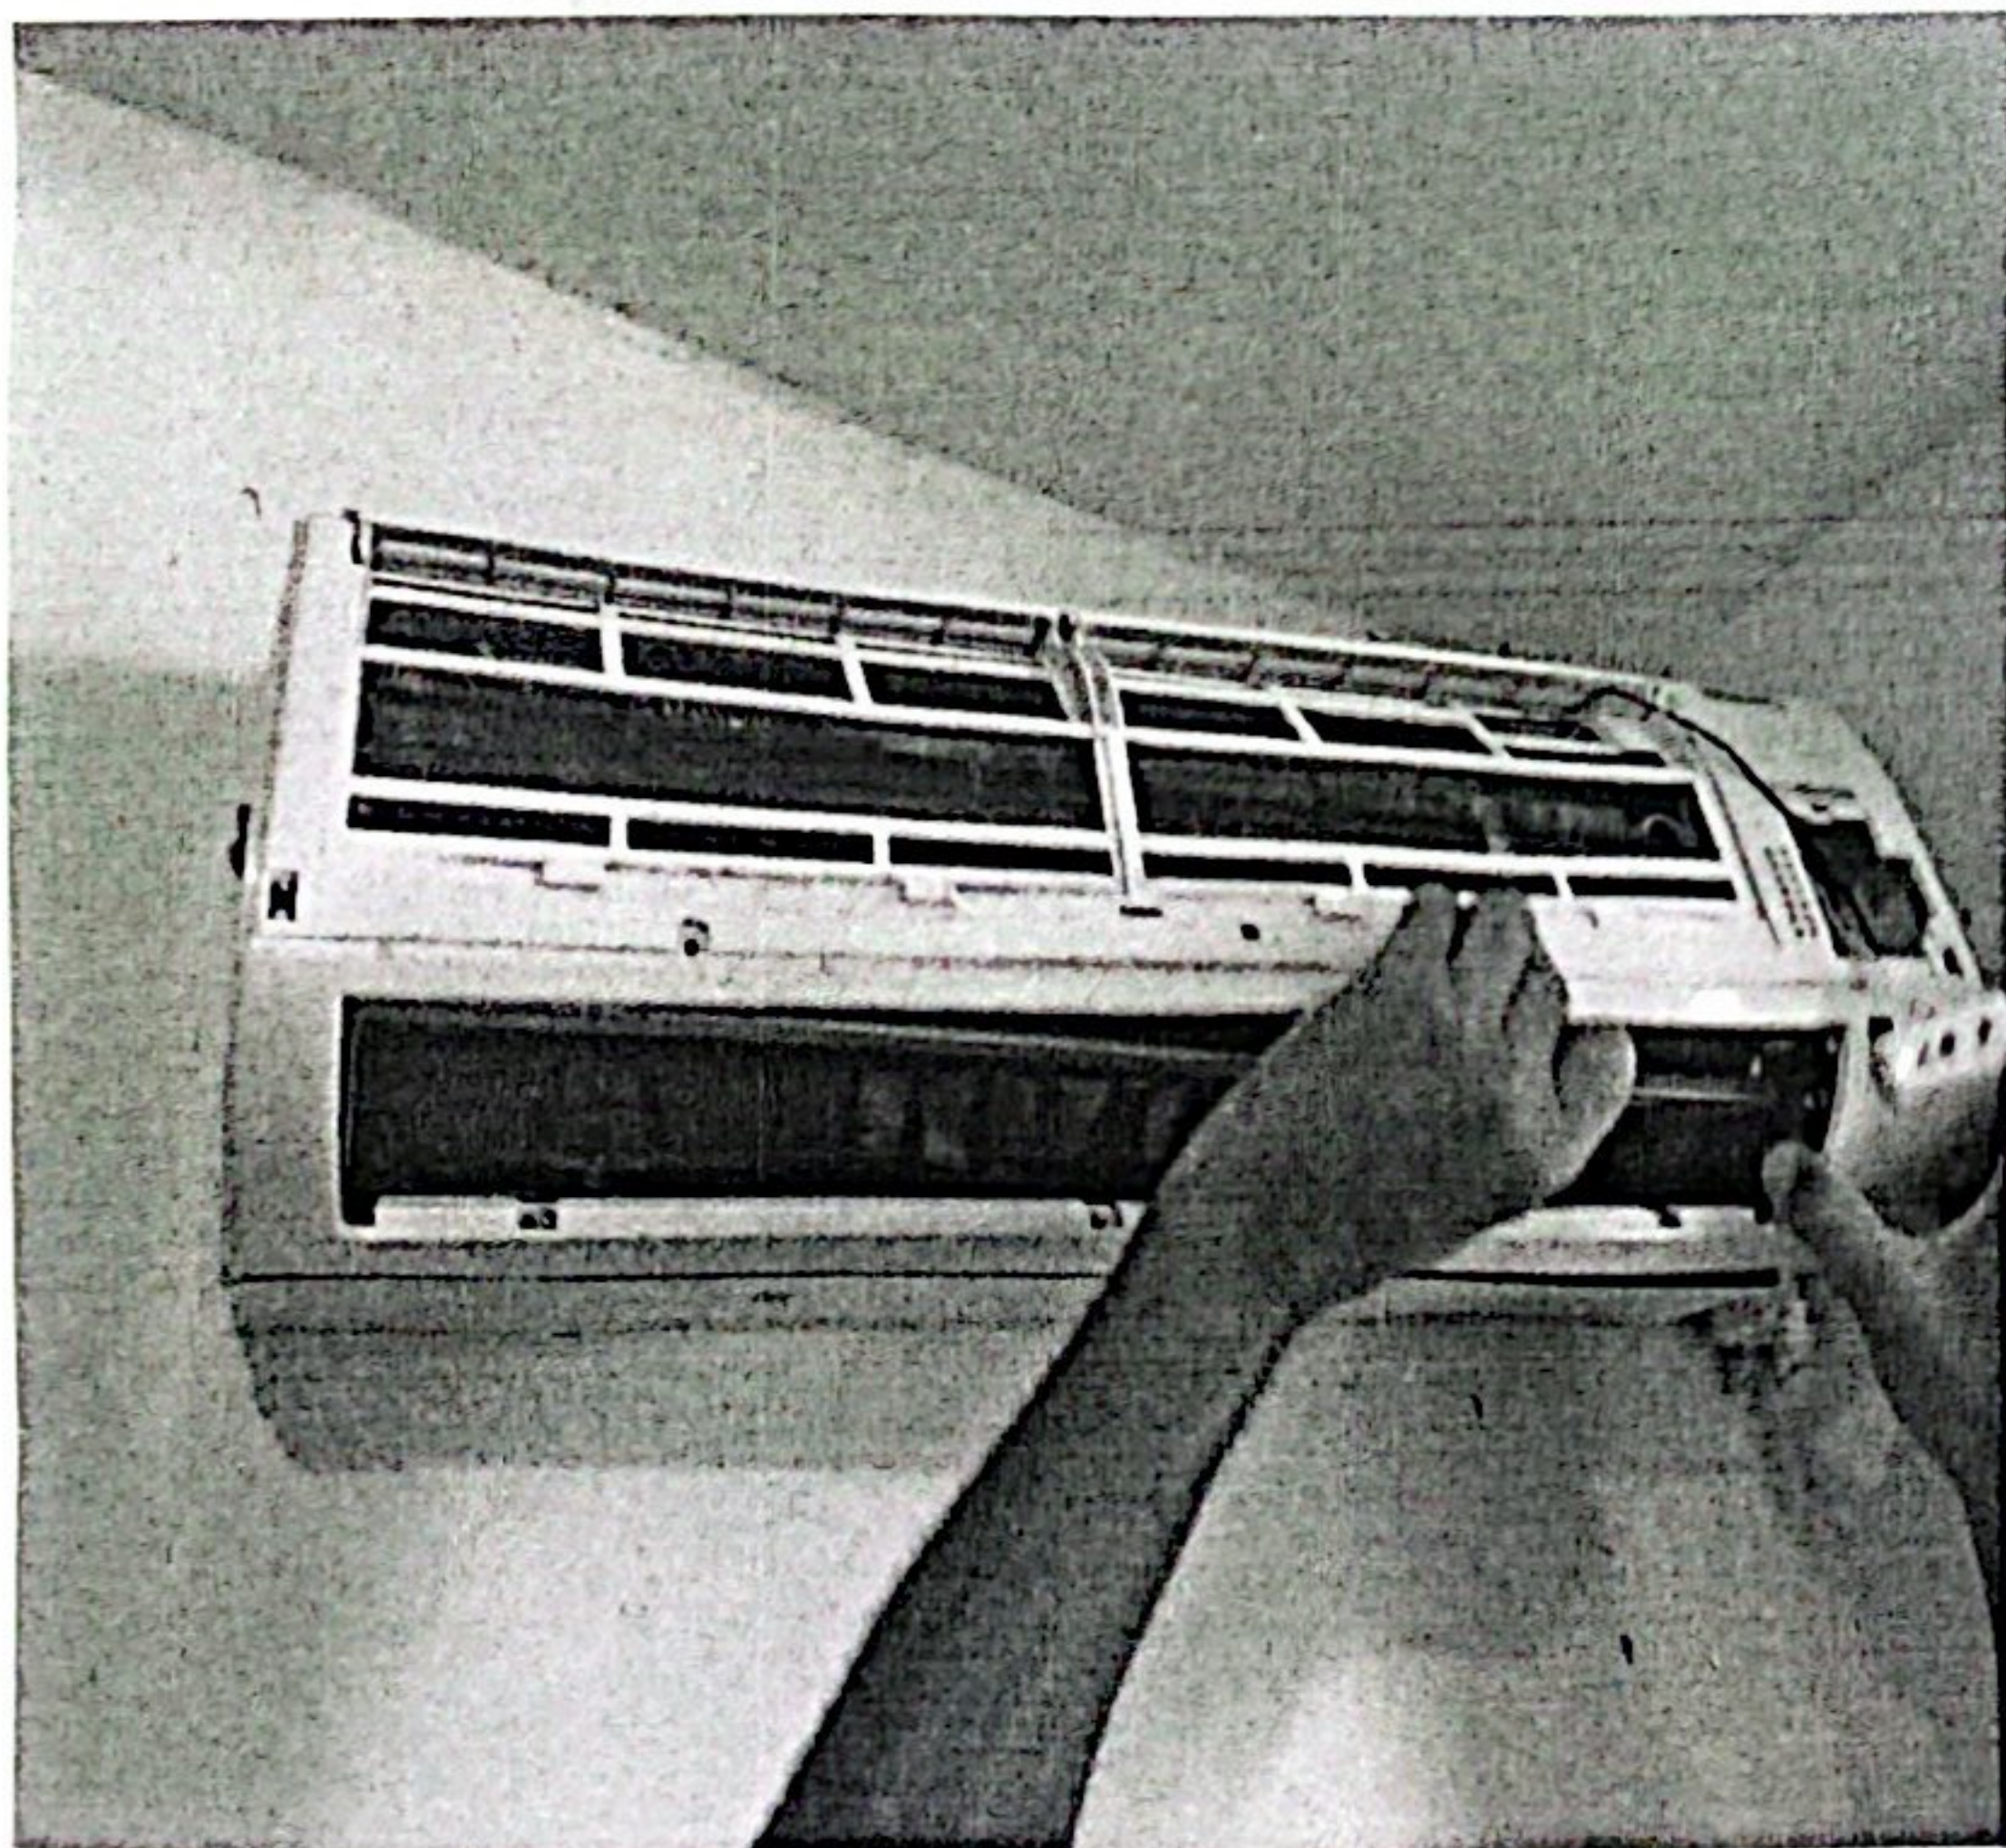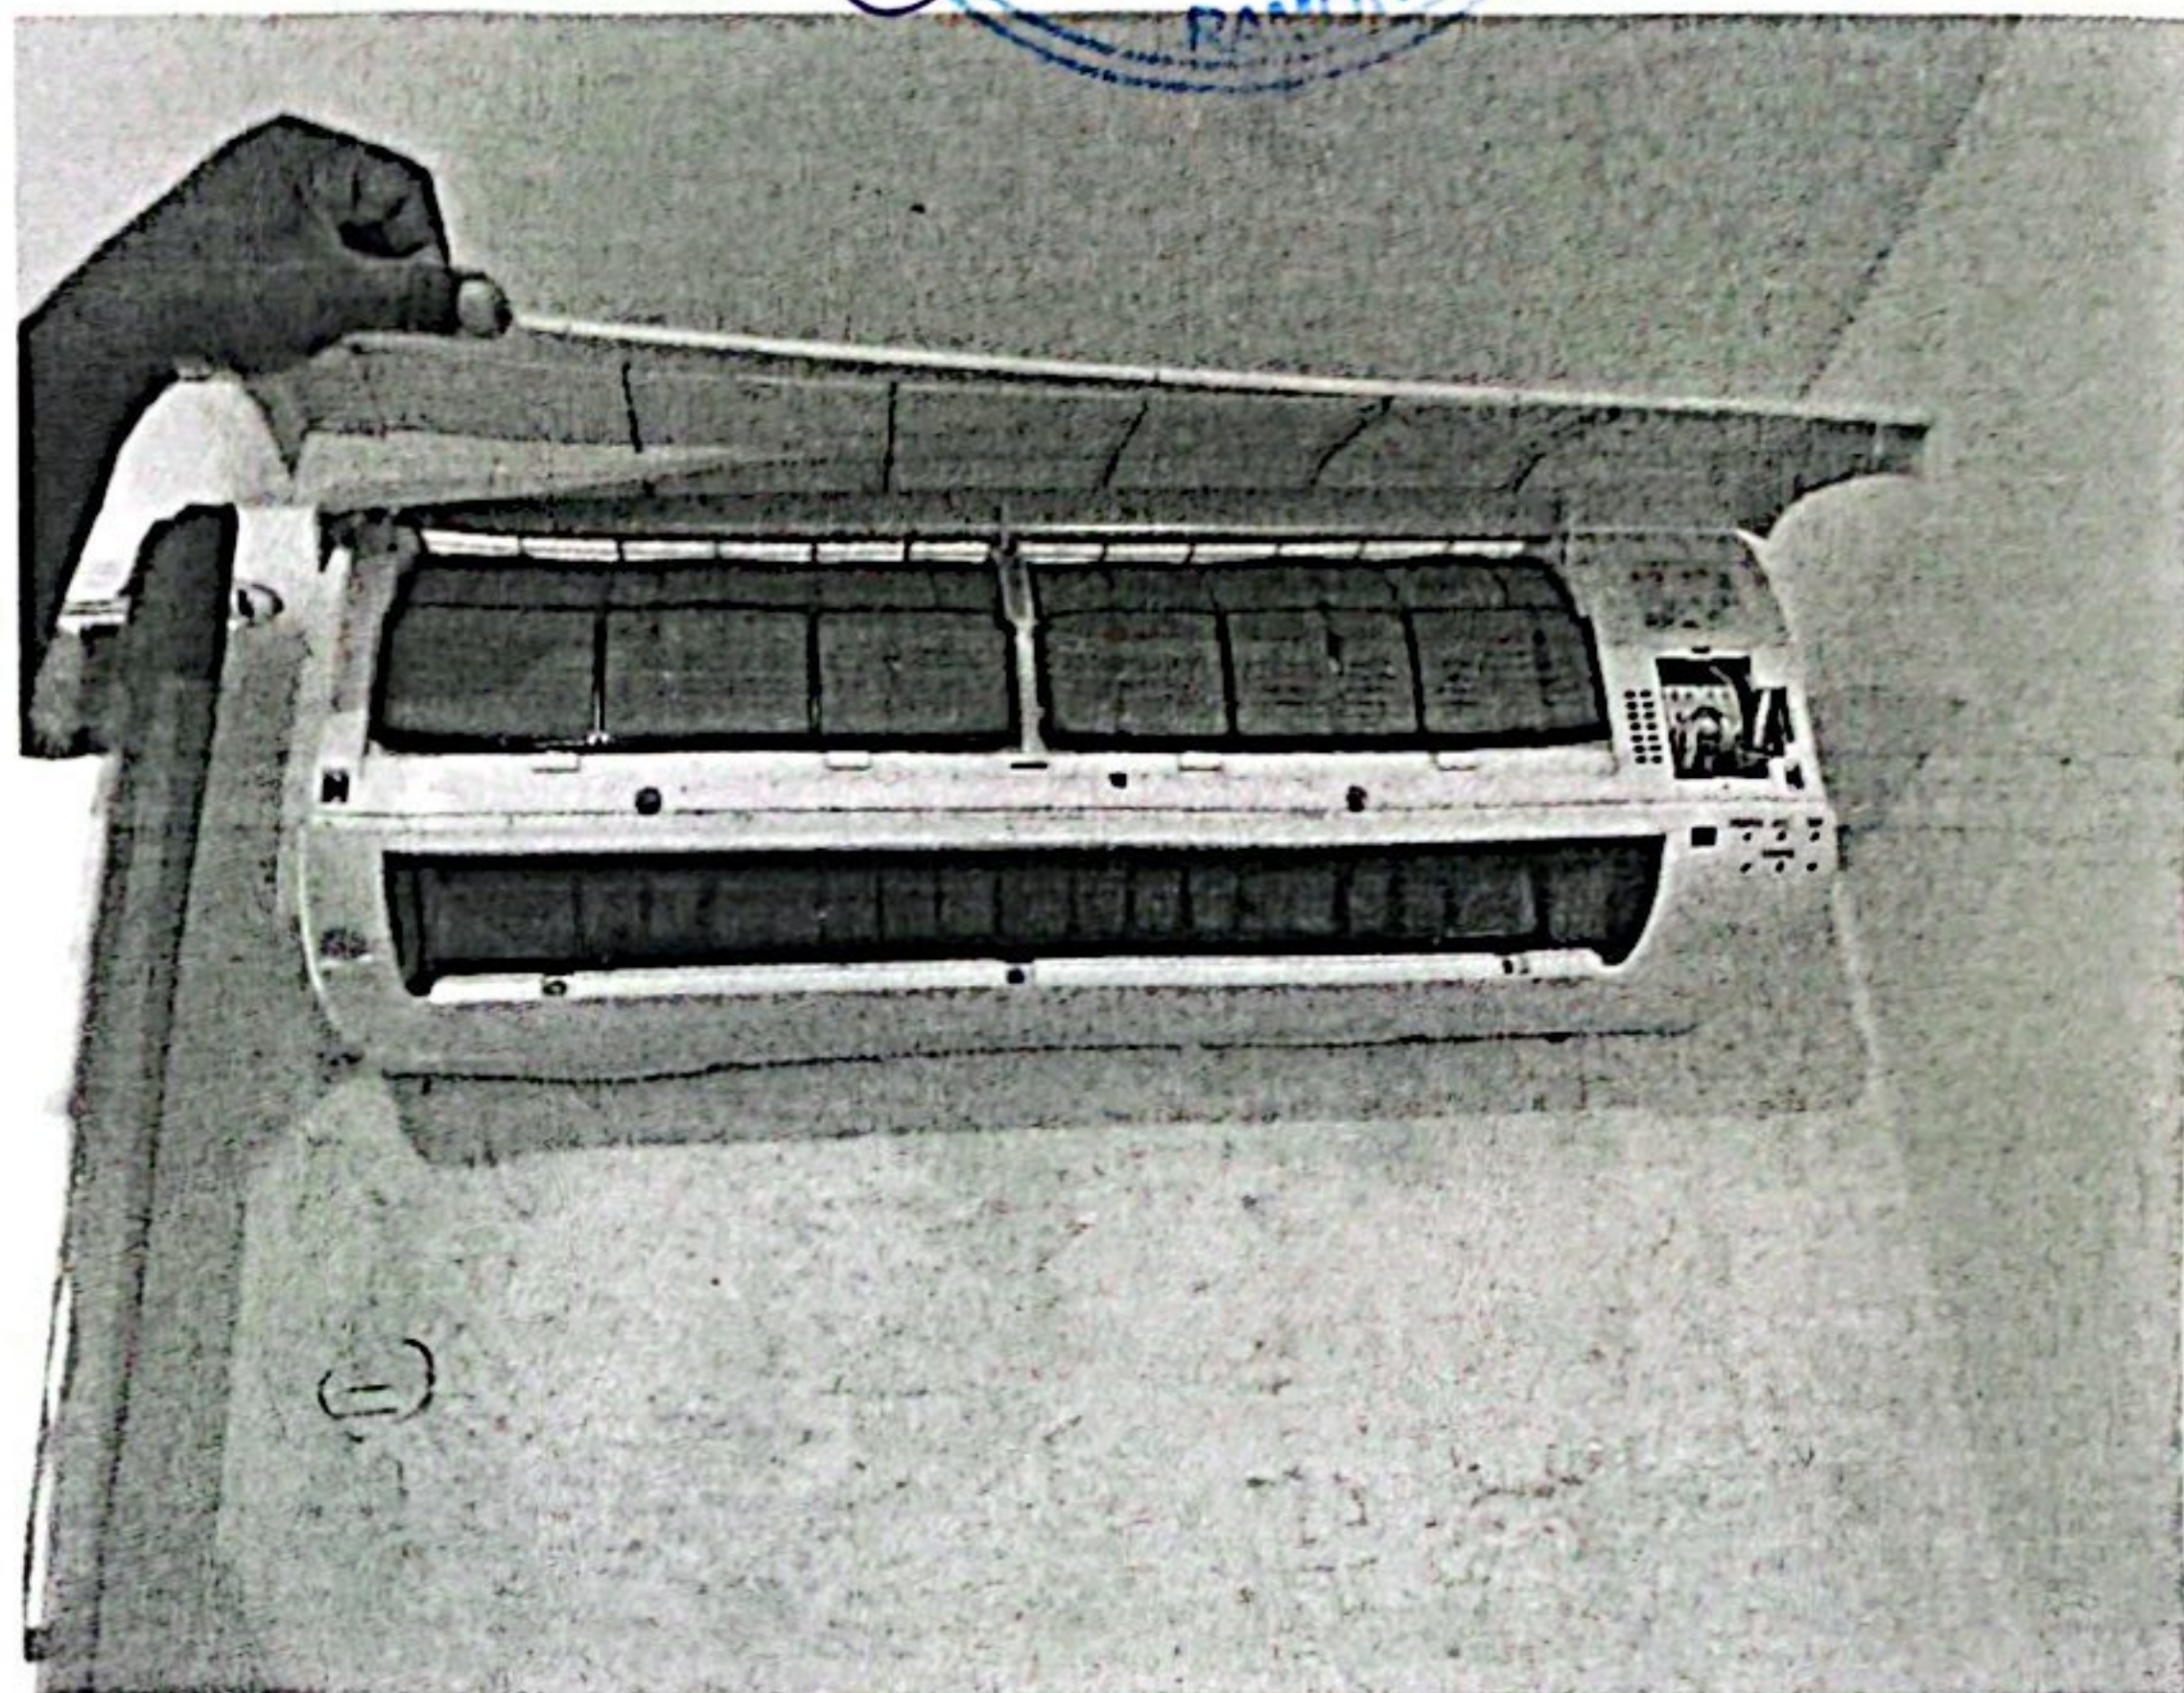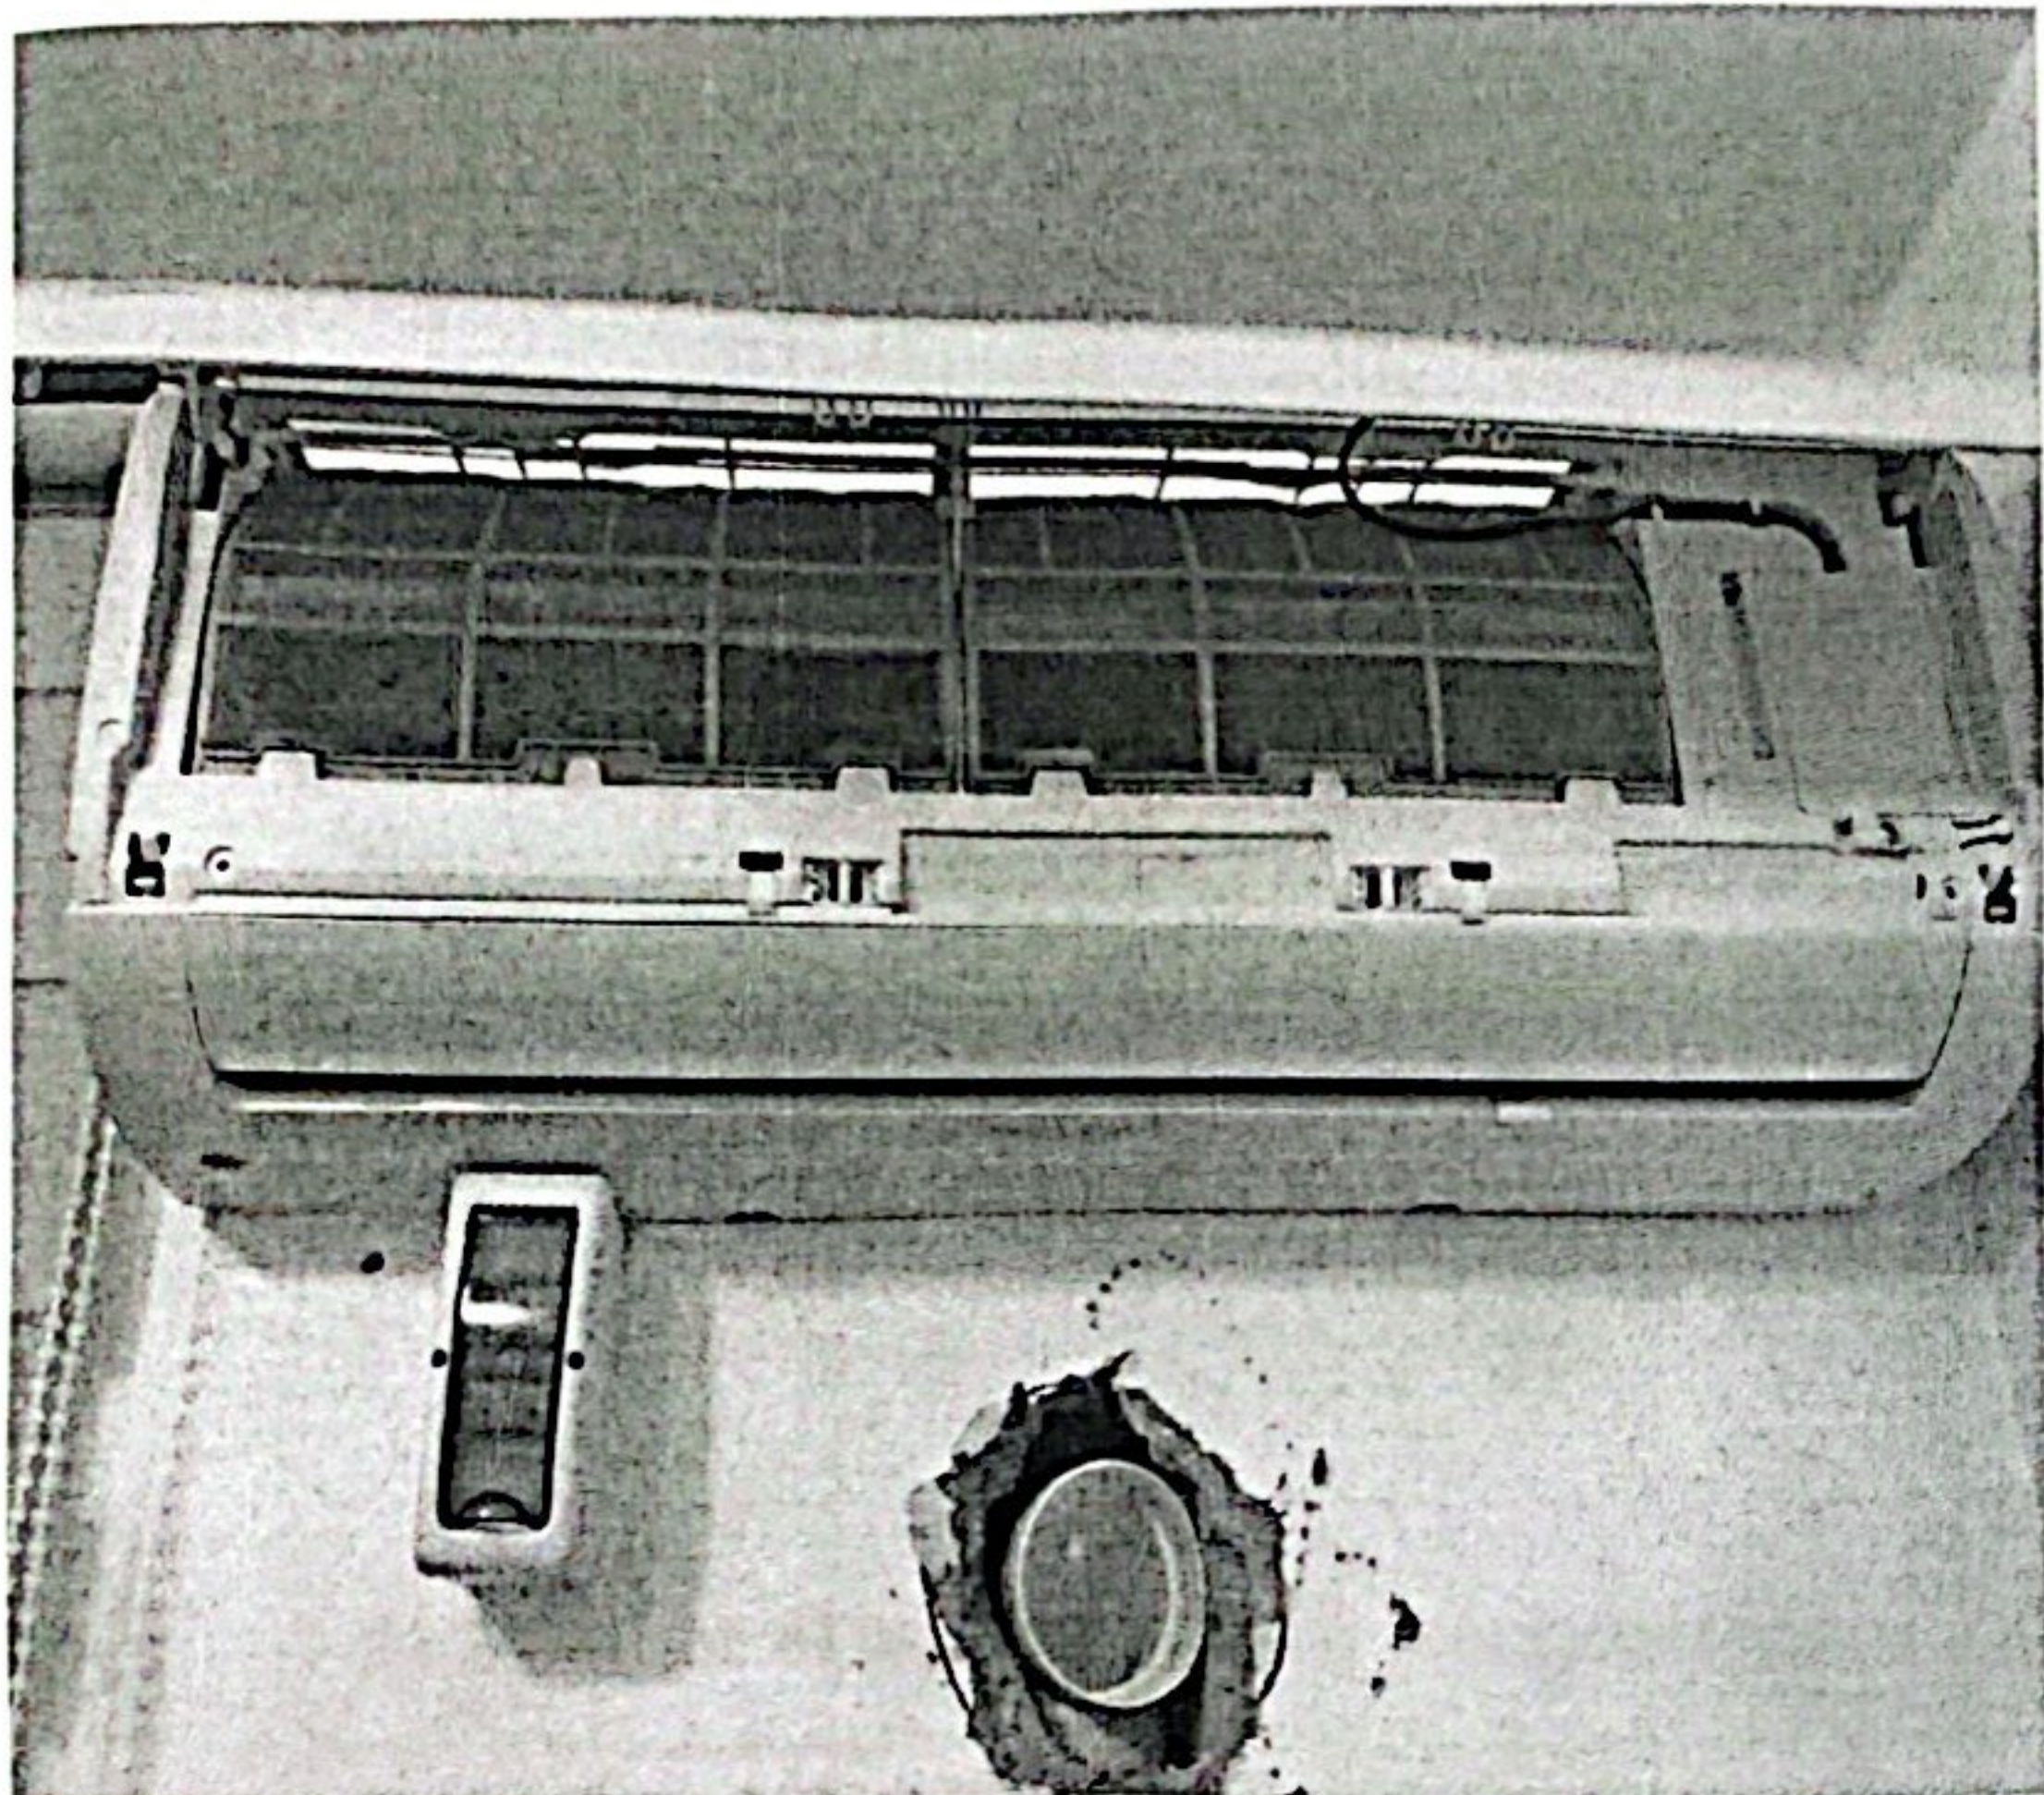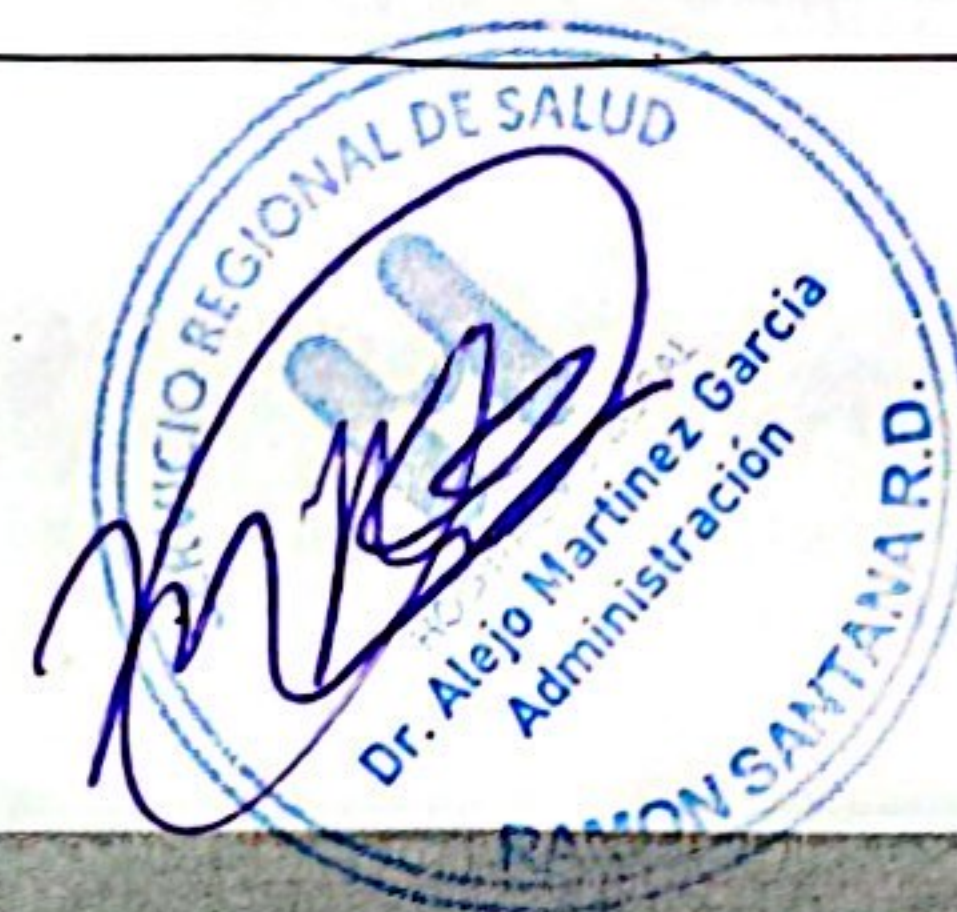






**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Registro de Equipos**  
DLC-FO-014- Versión: 01  
Fecha de aprobación: 26/07/2021

Informaciones Generales	
Nombre del establecimiento de salud: Hosp. Dr. Alejo Martínez García. R-S	Fecha: 27/01/2024
Regional de salud: V	Provincia: S-P-M
Nombre del responsable: MIGUEL A. RIVERA S.	
Cargo: A-D-M	Área: General.
Informaciones del Equipo	
Nombre del equipo:	Tipo o modelo:
Nombre del fabricante:	Núm. de serial:
Fecha de recepción del equipo:	Fecha de puesta en servicio: 31/01/2024
Estado en el momento de recepción: <input type="checkbox"/> Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input type="checkbox"/> Reacondicionado	
<b>Detalles del mantenimiento efectuado: chequeo correctivo y preventivo, limpieza de aire acondicionado.</b>  1- chequeo preventivo. Aire acondicionado laboratorio- limpieza de filtró chequeo eléctrico ventilador, compresor y puesto en marcha. 2- chequeo preventivo. Aire acondicionado sala de espera emergencia- limpieza de filtró chequeo eléctrico, ventilador, compresor y puesto en marcha. 3- chequeo preventivo. Aire acondicionado sala STO- de enfermería emergencia- limpieza de filtró chequeo eléctrico, ventilador, compresor y puesto en marcha. 4- chequeo preventivo. Aire acondicionado sala de cirugía- limpieza de filtró chequeo eléctrico, ventilador, compresor y puesto en marcha.	
<b>Detalles del mantenimiento a futuro: continuar con el chequeo preventivo para programar los mantenimiento correctivo a futuro para lograr un mejor funcionamiento del equipo y tener mejo utilidad.</b>	
<b>Historia de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o reparación:</b>	



Pedro Santana  
*Pedro Santana*  
Firma del responsable

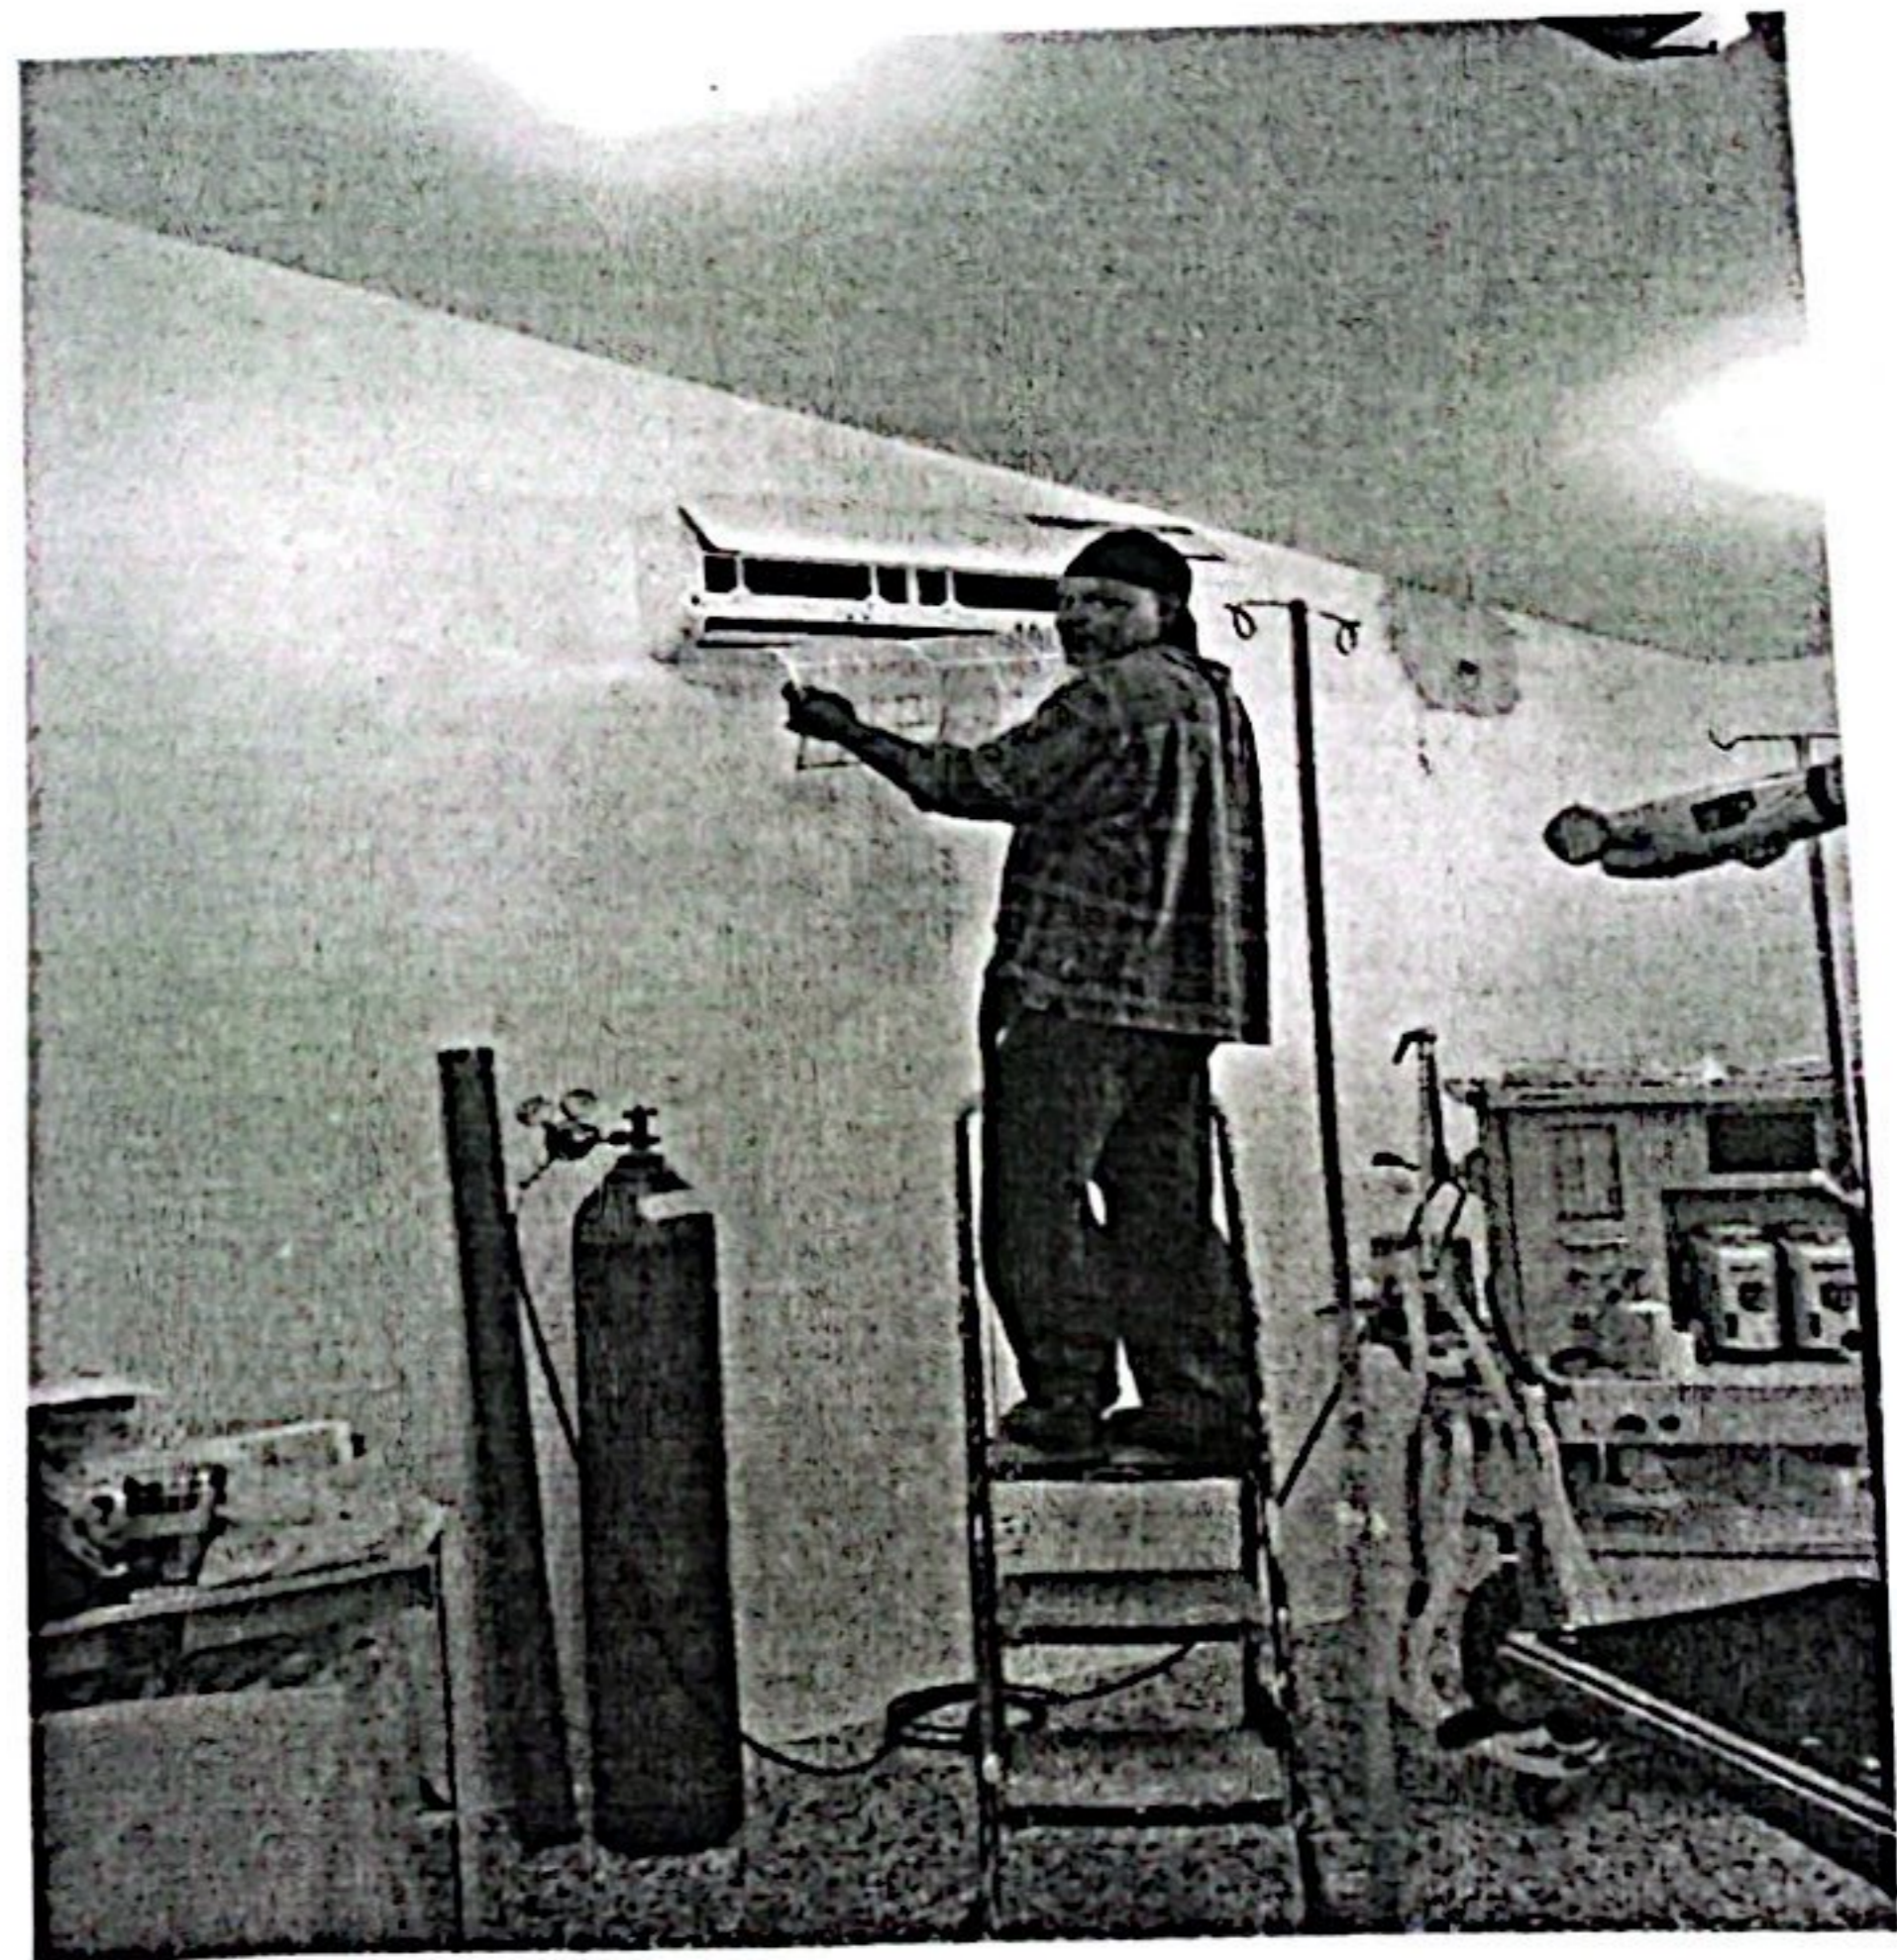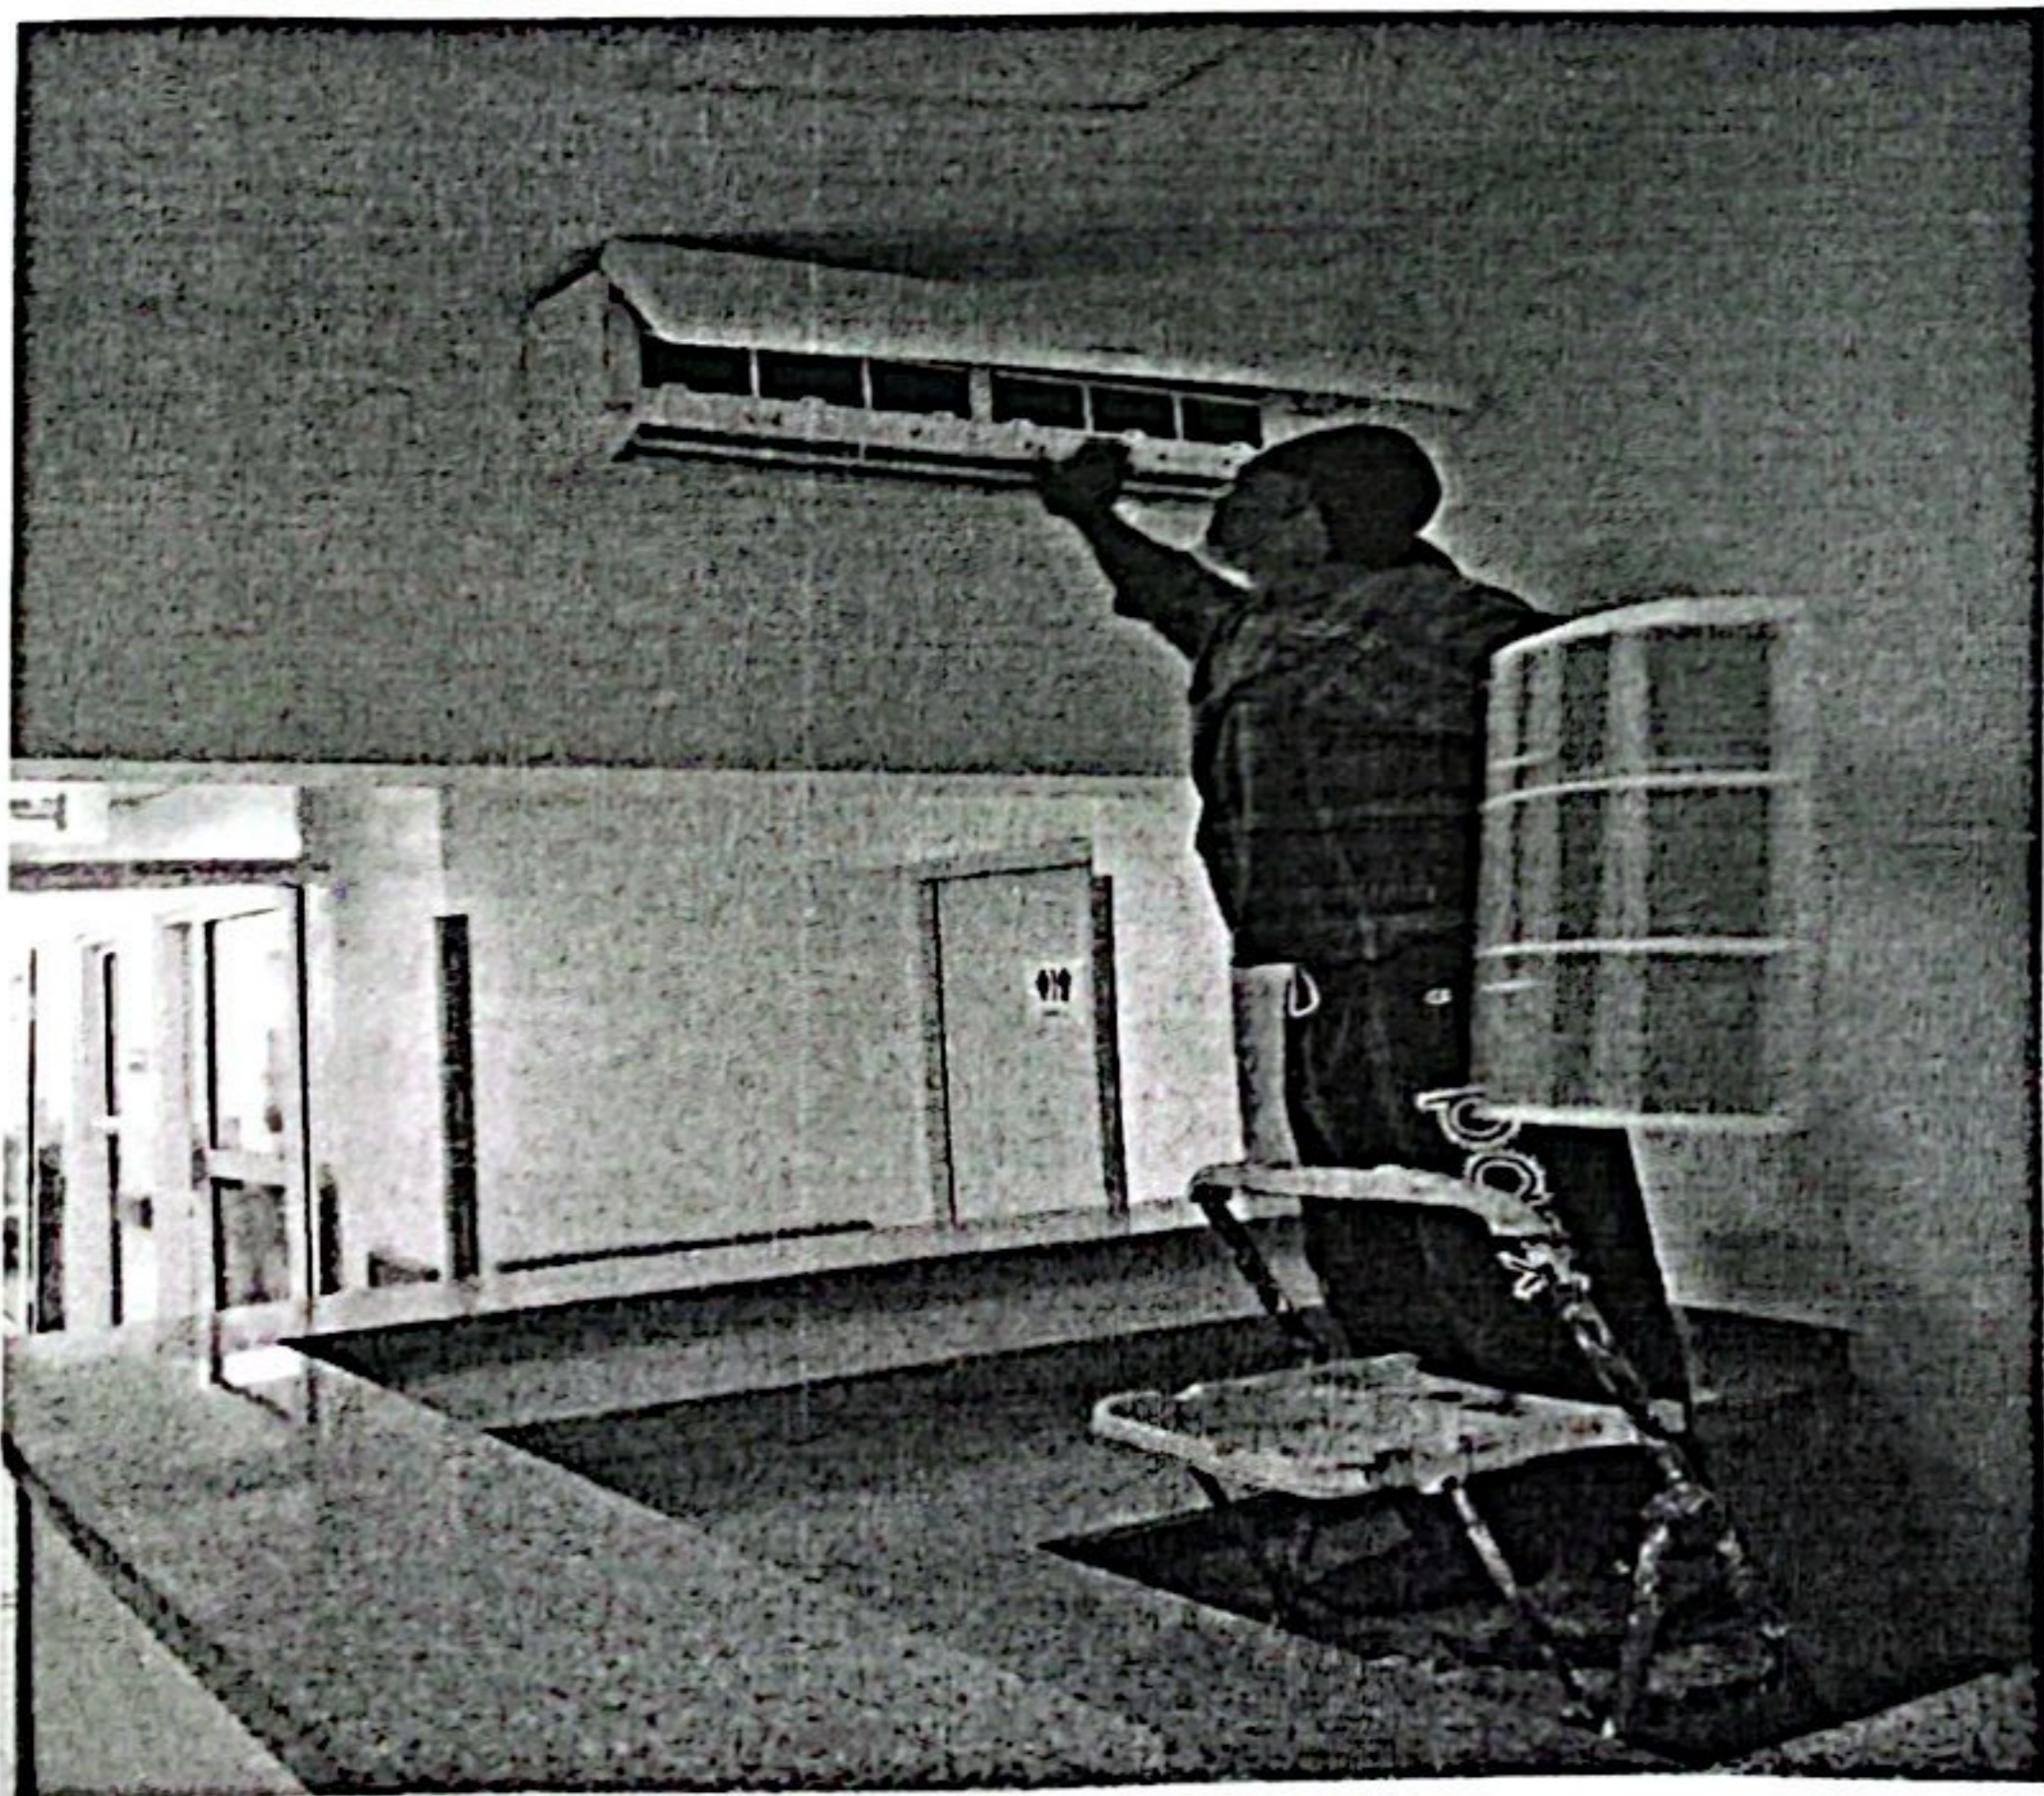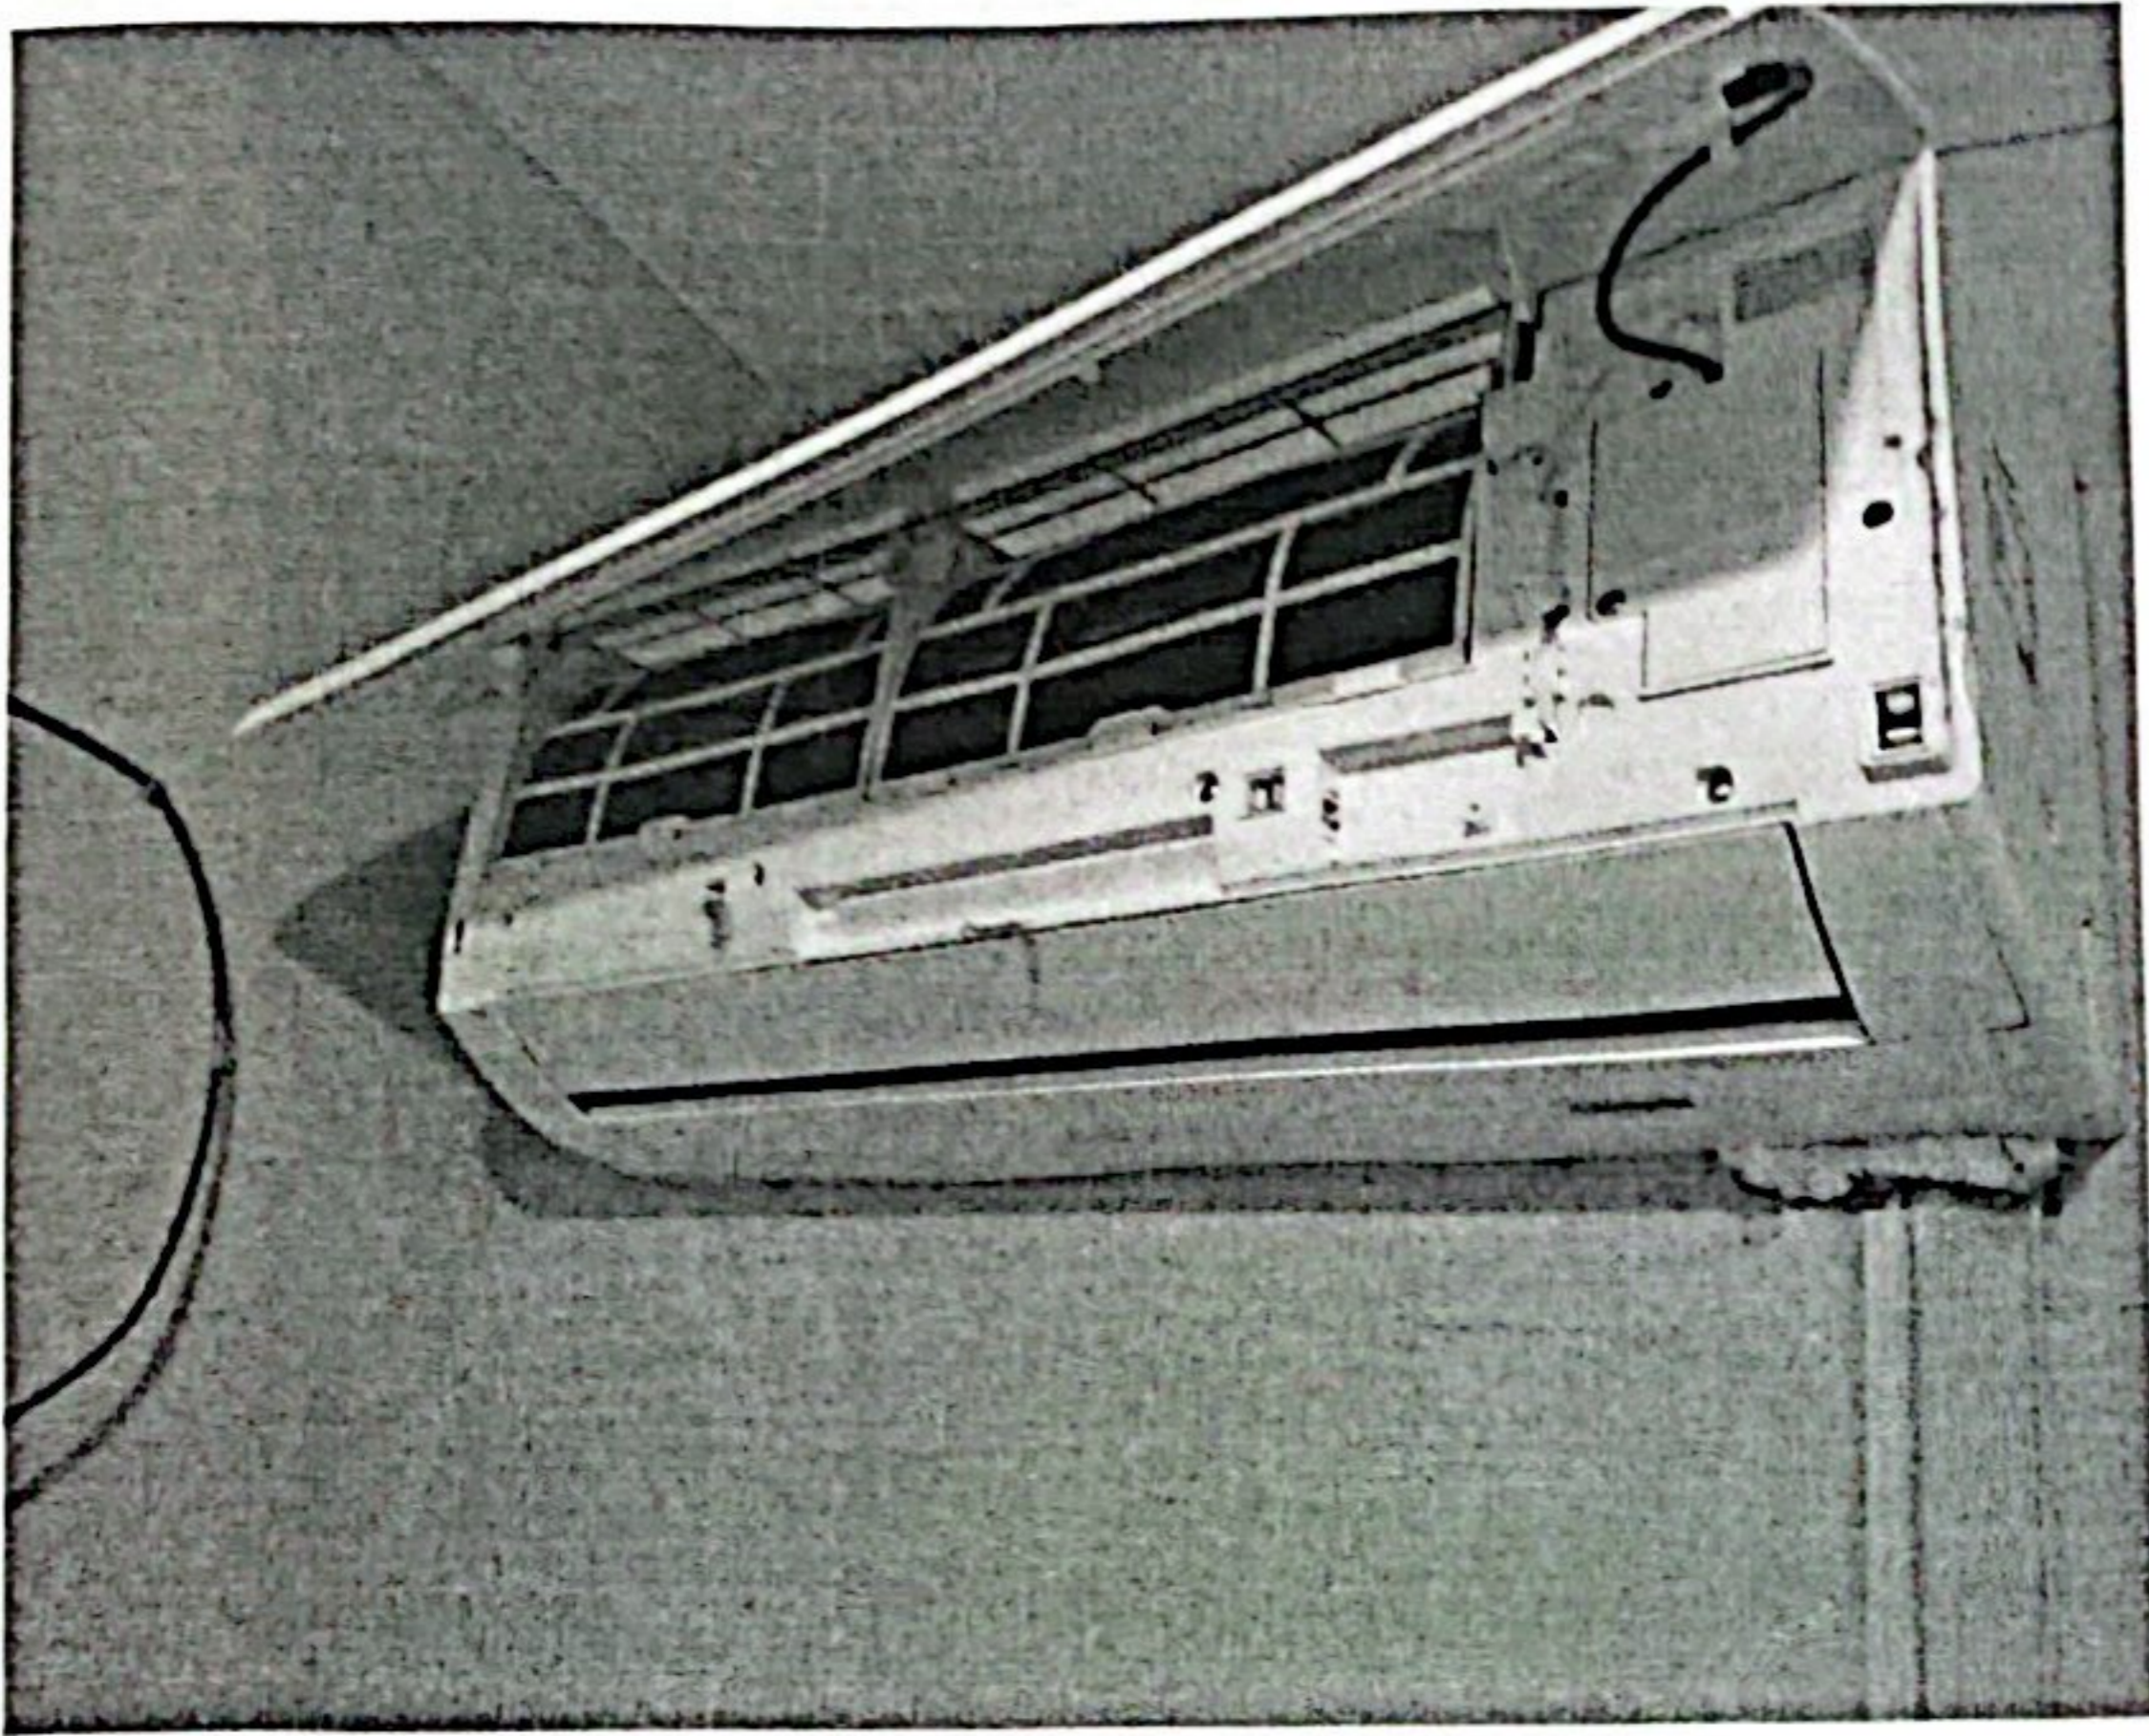

**FECHA:** 31/01/2024

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

**\*Nombre del lugar:** Hosp Doct. Alejo Martínez

**Área:** MANTENIMIENTO

**Nombre de la Actividad:** Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo 2024

**Código POA (Si aplica):**

### INTRODUCCIÓN

El mantenimiento se define como la preservación o conservación de una edificación y su contenido, para que sirva a su propósito establecido. Algunos autores lo definen como el “conjunto de actividades desarrolladas con el fin de conservar las propiedades (inmuebles, equipos, instalaciones, herramientas), en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido”.

### OBJETIVO DEL INFORME

Garantizar la operación confiable y sostenible de los activos fijos, maximizando su rendimiento y optimizando los costos a lo largo de su ciclo de vida, mediante la implementación de las mejores practicas de mantenimiento en la industria.

### METODOLOGIA (Si aplica)

El mantenimiento se realiza con la programación de la matriz de mantenimiento correctivo y preventivo que fue programa para el año completo, también cuenta con la matriz de seguimiento mensual para identificar los que hemos realizado correspondiente al mes que se está trabajando. Esta matriz permite que podamos realizar los que está programado para mantenimiento preventivo y correctivo.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

Mantenimiento correctivo aire acondicionado.

- 1-habitación M1 chequeo eléctrico, cambio de capacitor limpieza de filtro de aire y puesto en marcha.
  - 2- -habitación M2 chequeo eléctrico, cambio de capacitor limpieza de filtro de aire y puesto en marcha.
- LIMPIEZA DE FILTRO,CAMBIO DE CAPACITOR,DESMONTE DE LA UNIDAD M2 .

### RESULTADOS / CONCLUSIONES

Hemos logrado mejorar el servicios de mantenimiento con la matriz de seguimiento y los que se a programado se pudo identificar al gun problema en el proceso de chequeo preventivo, esto ayuda a que los equipos no se



dañen por completo y se pueda resolver a tiempo la problemática o fallas a futuro.

### RECOMENDACIONES

Continuar con el chequeo preventivo de los equipos, para tener un mejor funcionamiento y mejor utilidad y servicios de la unidad que fue trabajada.

### ANEXOS (Si aplica)

Como evidencia podemos mostrar foto, factura y la pieza. de la revisión que se le realizo al equipo de servicios en el informe general de mantenimiento

**Instrucciones de llenado:**

**\*Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Elaborado por  
(Nombre y apellido)  
Dr. Alejo Martinez Garcia  
Administración  
RAMON SANTANA R.D.







**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Registro de Equipos**  
DLC-FO-014- Versión: 01  
Fecha de aprobación: 26/07/2021

Informaciones Generales	
Nombre del establecimiento de salud: Hosp. Dr. Alejo Martínez García. R-S	Fecha: 31/01/2024
Regional de salud: V	Provincia: S-P-M
Nombre del responsable: MIGUEL A. RIVERA S.	
Cargo: A-D-M	Área: General.
Informaciones del Equipo	
Nombre del equipo:	Tipo o modelo:
Nombre del fabricante:	Núm. de serial:
Fecha de recepción del equipo:	Fecha de puesta en servicio:
Estado en el momento de recepción: <input type="checkbox"/> Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input type="checkbox"/> Reacondicionado	
Detalles del mantenimiento efectuado: chequeo y limpieza de aire acondicionado. 1-mantenimiento correctivo aire habitación medico M1- Nota- falto agregarlo en el plan. 2- mantenimiento correctivo aire habitación medico M2- Nota- falto agregarlo en el plan. 3-limpieza de filtro, cambio de capacitor, desmonte de la unidad m2- engrase de rolo del ventilador.	
Detalles del mantenimiento a futuro: realizar el mantenimiento preventivo en los meses correspondiente para seguir con el historial del equipo.	
Historia de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o reparación:	

BENJAMIN APONTE  
*Aponte A*  
Firma del responsable



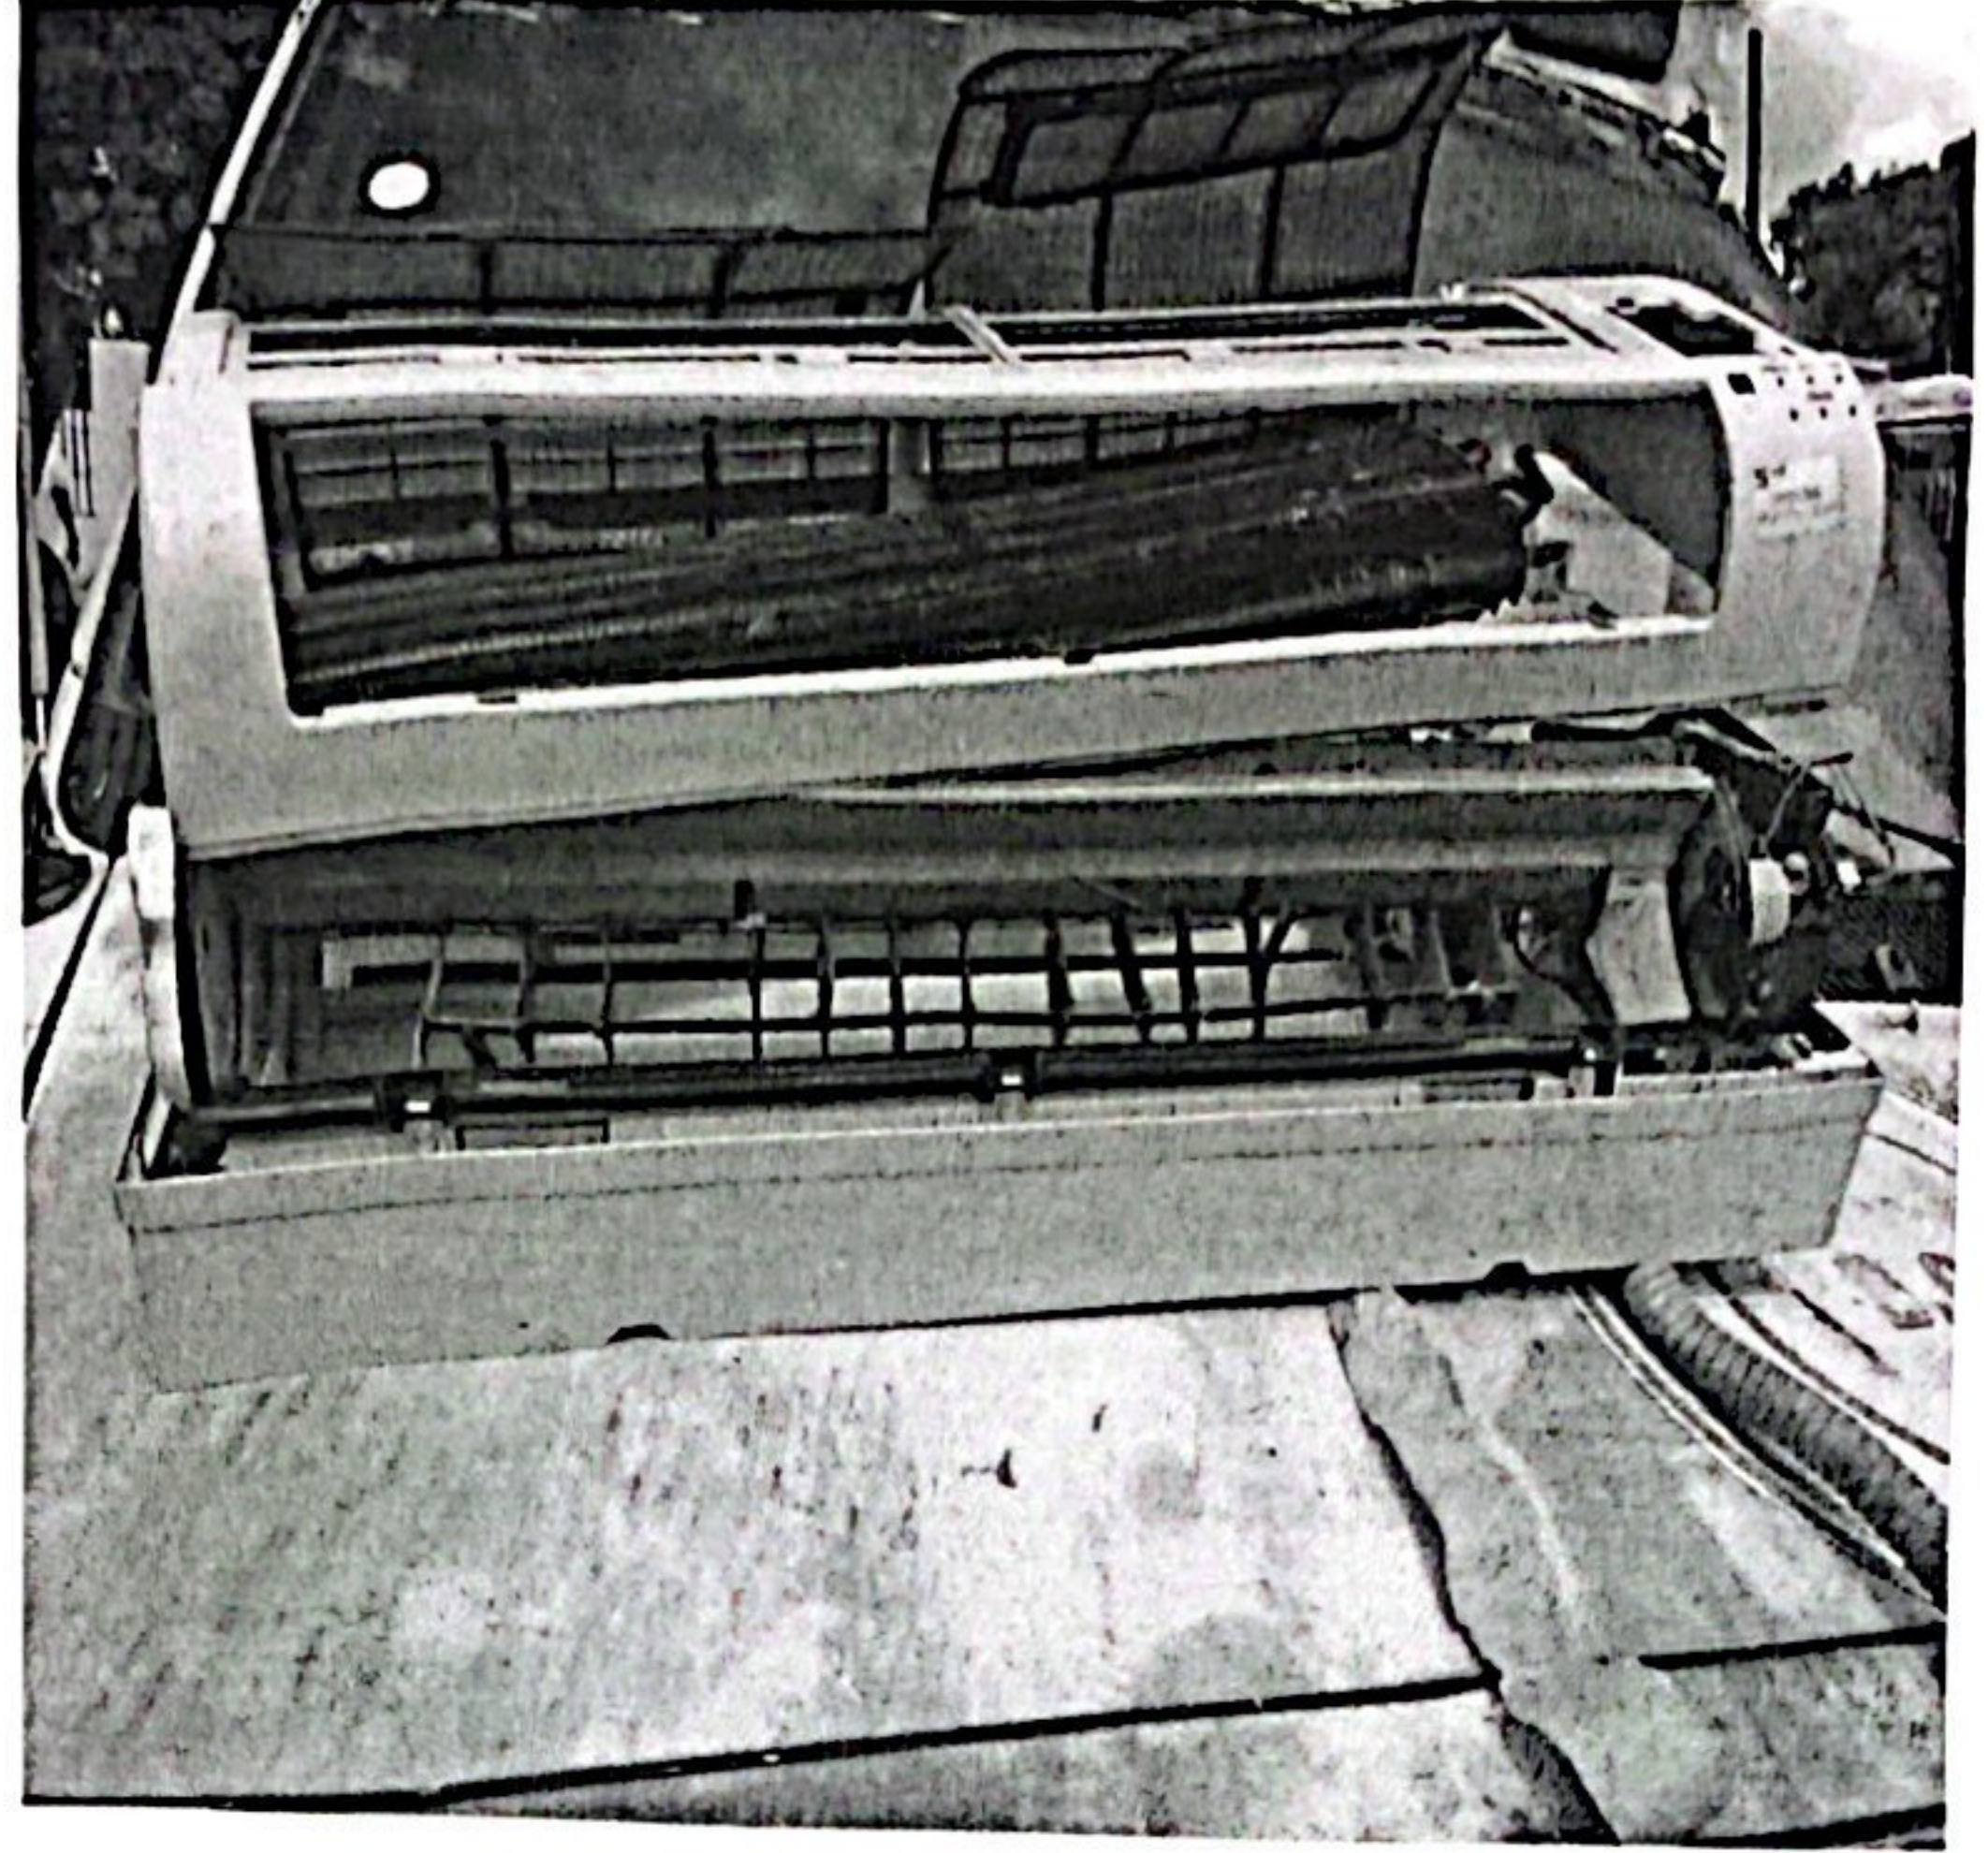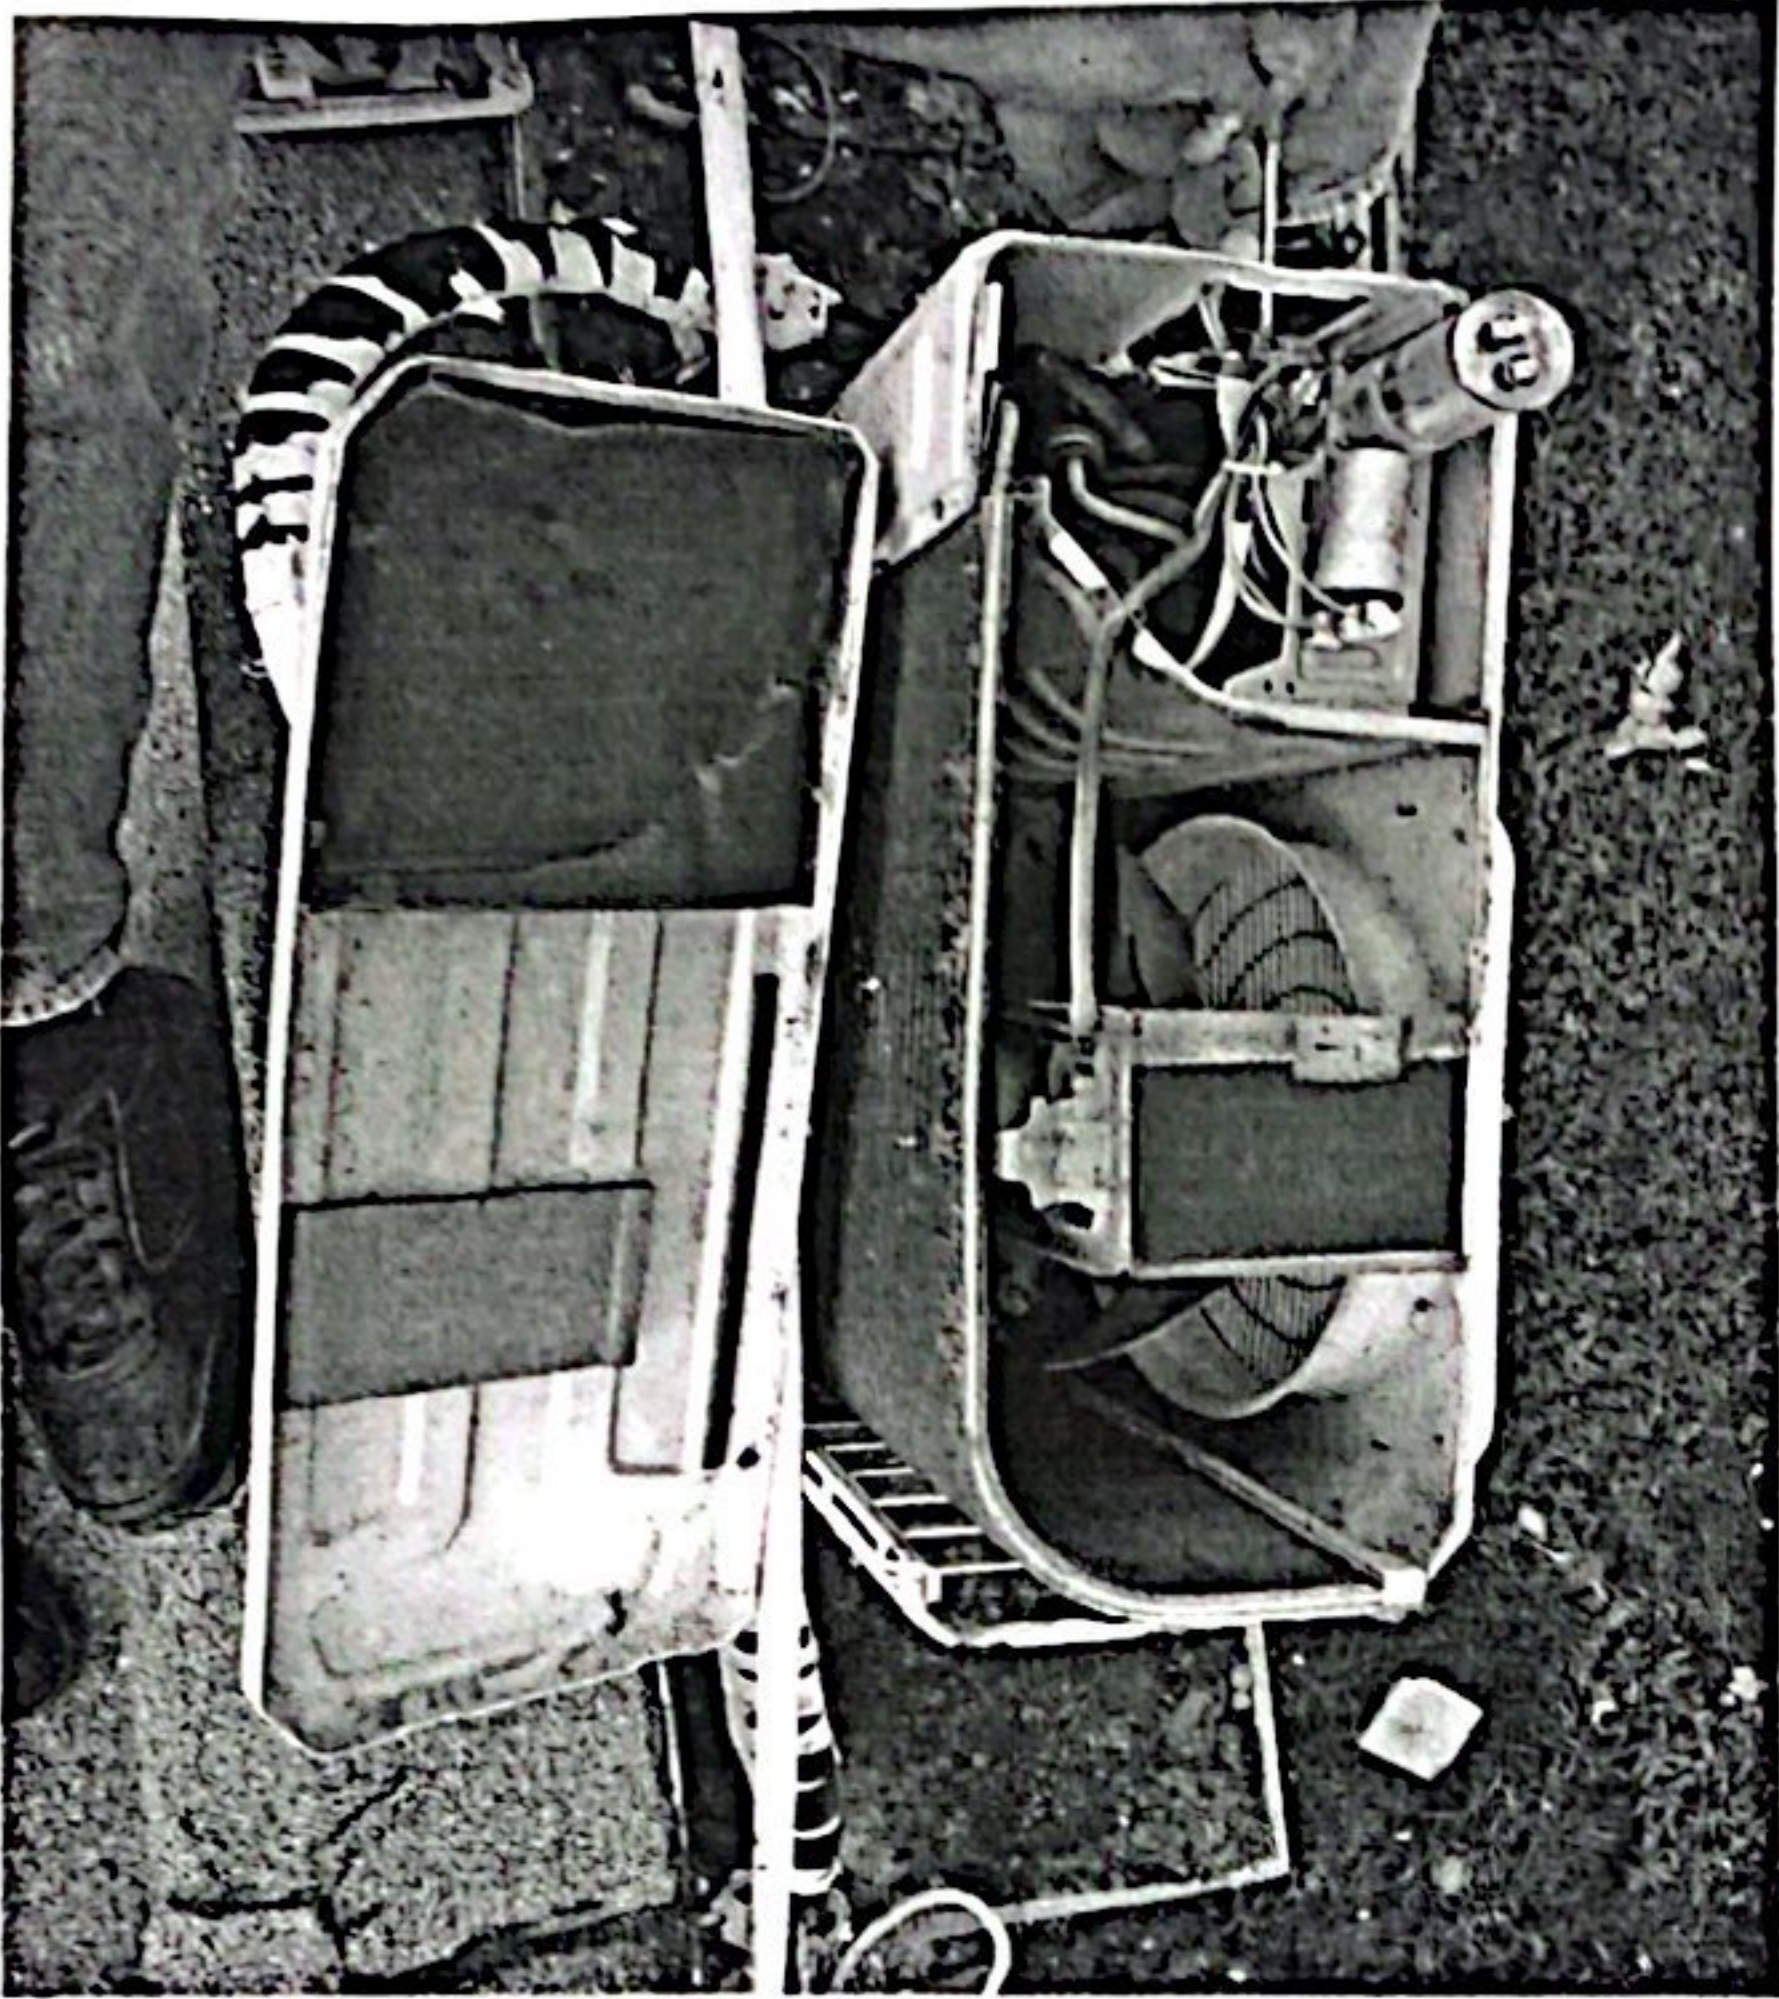

# REPORTE DE AIRE

N/o \_\_\_\_\_

FECHA: 31/01/2024

Vendido a: Hospital. Dr. Alejo Martínez

Dirección: Ramón santana

Tel: \_\_\_\_\_ condición: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Capacitor de para aire.	450	900
2	Relación de 2	2,500	5,000

Sub-Total **5,900**

Total a Pagar

*R. Apala*  
Entregado por



**FECHA:** 25/01/2024

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

**\*Nombre del lugar:** Hosp Doct. Alejo Martínez

**Área:** MANTENIMIENTO

**Nombre de la Actividad:** Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo 2024

**Código POA (Si aplica):**

### INTRODUCCIÓN

El mantenimiento se define como la preservación o conservación de una edificación y su contenido, para que sirva a su propósito establecido. Algunos autores lo definen como el “conjunto de actividades desarrolladas con el fin de conservar las propiedades (inmuebles, equipos, instalaciones, herramientas), en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido”.

### OBJETIVO DEL INFORME

Garantizar la operación confiable y sostenible de los activos fijos, maximizando su rendimiento y optimizando los costos a lo largo de su ciclo de vida, mediante la implementación de las mejores practicas de mantenimiento en la industria.

### METODOLOGIA (Si aplica)

El mantenimiento se realiza con la programación de la matriz de mantenimiento correctivo y preventivo que fue programa para el año completo, también cuenta con la matriz de seguimiento mensual para identificar los que hemos realizado correspondiente al mes que se está trabajando. Esta matriz permite que podamos realizar los que está programado para mantenimiento preventivo y correctivo.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

- . Mantenimiento programado :
- 1-camilla de emergencia.
  - 2-equipos tecnológicos. En el área de archivo-facturación-administración-RRHH-
  - 3-unidad de sonógrafo.
  - 4-impresora administración.
  - 5- camilla ginecología.



**RESULTADOS / CONCLUSIONES**

Logramos identificar los que se realizó y también ver los que no se pudo realizar y programar para el próximo mes.

**RECOMENDACIONES**

Continuar con el chequeo preventivo de los equipos, para tener un mejor funcionamiento y mejor utilidad y servicios de la unidad que fue trabajada.

**ANEXOS (Si aplica)**

**Instrucciones de llenado:**

**\*Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

  
Elaborado por  
(Nombre y apellido)  
Dr. Alejo Martínez García  
Administración  


**PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA FISICA 20**  
(Fecha: 15Enero-2024.)

Fecha de aprobación: 4/05/2021

NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD	ACTIVIDAD	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- sala de espera emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. Y Correctivo	trimestral	28/01/2023	28/04/2024	*													Se realizan por Area
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- sto. De enfermeria emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. Y Correctivo	trimestral	28/01/2024	28/04/2023	*													Se realizan por Area
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- area de cura emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. Y Correctivo	Semestral	10/10/2023	18/04/2024				*										según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- area de nebulizacion emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. Y Correctivo	Semestral	10/10/2023	18/04/2024				*										según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- area de facturacion emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. Y Correctivo	Semestral	10/10/2023	18/04/2024				*										prestado a la direccion - se realizar el mant. En esa area.
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- area de triaje emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. Y Correctivo	Semestral	10/10/2023	18/04/2024				*										fuera de servicios
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Aires acondicionado- area de cuarto electrico emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. Y Correctivo	Semestral	10/10/2023	18/04/2024				*										según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Nebulizador	chequeo revision	correctivo y preventivo	Semestral	25/01/2024	25/07/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Nebulizador	chequeo revision	correctivo y preventivo	Semestral	25/01/2024	25/07/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Camilla Observacion	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024	*													Programada por el técnico
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Camilla Observacion	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/06/2023	15/02/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Camilla Cura	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/06/2023	15/02/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Camilla Triaje	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/06/2023	15/02/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Equipos Tecnologicos Triaje	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/06/2023	15/02/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Emergencia Balanza Triaje	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/06/2023	15/02/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Planta electrica G1	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/11/2023	15/02/2024														fuera de servicios en proceso de reparacion.
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Planta electrica G2	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/11/2023	15/02/2024														según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Ambulancia H1	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/10/2023	15/04/2024				*										chequeo de tempera diario
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Nevera de cocina y despensa	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/10/2023	15/04/2024				*										chequeo de tempera diario
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Nevera de Farmacia	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/10/2023	15/04/2024				*										se realiza por la casa comercial
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Maquina de Laboratorio Hemograma	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024				*										se realiza por la casa comercial
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Maquina de Laboratorio Química	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	12/09/2023	15/03/2024				*										según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Centrifuga de 6 tubos	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024				*										según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Colorimetro	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024				*										según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Aire acondicionado. LAB	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	25/01/2024	25/04/2024	*													Programada por el técnico
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Computos	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024	*													Programada por el técnico
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Rotador de VDRL	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024				*										chequeo de tempera diario
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Nevera de Laboratorio	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024				*										caso comercial
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Microscopio	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024				*										según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Odontologia	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024				*										según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Compresor de aire Odontologia	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	25/01/2024	25/07/2024	*													suplidor externo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Aire acondicionado Odontologia	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	12/12/2023	12/03/2024				*										según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Unidad de Odontologia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/12/2023	15/03/2024				*										Programada por el técnico
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Horno Esterilizador	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	12/10/2023	20/02/2024				*										Programada por el técnico
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Unidad de Sonografía	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024				*										chequeo de tempera diario
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Nevera de Vacuna	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024				*										según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Frizer de Vacuna	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024				*										según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico puesto de Vacuna	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/01/2024	15/07/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Aire Acondicionado Monografía	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/01/2024	15/07/2024	*													según el uso del equipo



HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Equipo Sonográfico Sonografía	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/10/2023	15/03/2024	*													Programada por el técnico
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	UPS-DE-BATERIA Sonografía	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Computos	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024	*													Programada por el técnico
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Balanza Pediatrica	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Pediatrica	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024				*										según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Consultorio General	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024				*										Programada por el técnico
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Consultorio Ginecologia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024				*										Programada por el técnico
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Camilla Consultorio Ginecologia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/01/2024	*													Programada por el técnico
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Aire Acondicionado Archivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024	*													Programada por el técnico
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Archivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024	*													Programada por el técnico
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Archivo. Fac	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024	*													Programada por el técnico
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Oficina RRHH	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024	*													Programada por el técnico
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Contabilidad	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologico. Amd. Secre	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Impresora Oficina.Amd	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	15/02/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Aire Acondicionado AMD.	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	15/02/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Aire Acondicionado Direccion	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	15/02/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Equipos tecnologicos Direccion	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024				*										según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Impresora Oficina.Direccion	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/10/2023	15/04/2024				*										chequeo de tempera diario
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Maquina de anestesia. Cirugia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/10/2023	15/04/2024				*										suplidor externo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Productos de limpieza	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	20/02/2024	*													suplidor externo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Despensa	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	15/03/2024				*										según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Esterilizador en Cirugia	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	25/01/2024	25/04/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Camillas de Cirugia	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	25/01/2024	25/04/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Aire Acondicionado Cirugia	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	15/02/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Aspirador	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/12/2023	15/03/2024				*										según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Camilla sala de Cirugia	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024				*										según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Nevera Cuarto de Cirugia	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	15/02/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Camilla sala de Cirugia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	25/01/2024	25/04/2024	*													según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Camilla sala de Cirugia	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	25/01/2024	25/04/2024	*													Programada por el técnico
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Cunero Parto	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/10/2023	15/02/2024				*										según el uso del equipo
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Lampara Cuello de Ganzo Parto	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/10/2023	15/03/2024				*										Programada por el técnico
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Camilla Ginecologia Parto	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024				*										Programada por el técnico
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ	Abanico Parto	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	10/02/2024	*													
HOSP DR. ALEJO MARTINEZ																				

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

Instalación / Maquinaria	Elementos	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. y Correct.	Periodicidad para Revisión	Ultimo Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Aires acondicionado- sala de espera emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. y Correctivo	trimestral	25/01/2024	25/04/2024	*											chequeo preventivo	
Aires acondicionado- sto. De enfermeria emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. y Correctivo	trimestral	25/01/2024	25/04/2024	*											chequeo preventivo	
Aires acondicionado- area de cura emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. y Correctivo	Semestral	10/10/2023	15/04/2024													
Aires acondicionado- area de nebulizacion emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. y Correctivo	Semestral	10/10/2023	15/04/2024													
Aires acondicionado- area de facturacion emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. y Correctivo	Semestral	10/10/2023	15/04/2024													
Aires acondicionado- area de triaje emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. y Correctivo	Semestral	10/10/2023	15/04/2024													
Aires acondicionado- area uso cuarto estanco emergencia	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento reparacion e instalacion	mantenimiento prevent. y Correctivo	Semestral	10/10/2023	15/04/2024													
Emergencia Nebulizador	chequeo revision	chequeo revision	correctivo y preventivo	Semestral	25/01/2024	25/07/2024	*												
Emergencia Nebulizador	chequeo revision	chequeo revision	correctivo y preventivo	Semestral	25/01/2024	25/07/2024	*												
Emergencia Camilla Observacion	chequeo y revision	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/01/2023	25/02/2024	*											Programada	
Emergencia Camilla Observacion	chequeo y revision	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/06/2023	15/02/2024													
Emergencia Camilla Cara	chequeo y revision	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/06/2023	15/02/2024													
Emergencia Camilla Triage	chequeo y revision	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/06/2023	15/02/2024													
Emergencia Equipos Tecnologicos Triage	chequeo y revision	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/06/2023	15/02/2024													
Emergencia Balanza Triage	chequeo y revision	chequeo y revision	correctivo y preventivo	Semestral	15/06/2023	15/02/2024													
Planta electrica G1	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/11/2023	15/02/2024													
Planta electrica G2	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/11/2023	15/02/2024													
Ambulancia H1	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/11/2023	15/02/2024													
Nevera de cocina y despensa	chequeo	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/10/2023	15/04/2024													
Nevera de Farmacia	chequeo	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/10/2023	15/04/2024													
Maquina de Laboratorio Hemograma	chequeo	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024													
Maquina de Laboratorio Quimica	chequeo	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	12/09/2023	15/03/2024													
Centrifuga de 6 tubos	chequeo	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024													
Colorimetro	chequeo	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024													
Aire acondicionado	chequeo	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	15/01/2024	15/04/2024	*												
Equipos tecnologicos. Computos	chequeo	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024													
Rotador de VDRU	chequeo	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024													
Nevera de Laboratorio	chequeo	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024													
Microscopio	chequeo	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024													
Abanico Odontologia	chequeo	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024													
Compresor de aire Odontologia	chequeo	chequeo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024													
Aire acondicionado Odontologia	chequeo	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/01/2024	15/04/2024	*												
Unidad de Odontologia	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	12/12/2023	12/03/2024													
Horno Esterilizador	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024													
Unidad de Sonografía	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	12/10/2023	20/02/2024													
Nevera de Vacuna	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024													
Frizer de Vacuna	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024													
Abanico puesto de Vacuna	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024													
Aire Acondicionado Monografía	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/01/2024	15/07/2024	*												
Equipo Sonográfico Sonografía	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/10/2023	15/02/2024													
UPS-DE-BATERIA Sonografía	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024													
Equipos tecnologicos. Computos	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024													
Balanza Pediatría	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024													
Abanico Pediatría	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024													
Abanico Consultorio General	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024													
Abanico Consultorio Ginecología	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024													
Camilla Consultorio Ginecología	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024													
Aire Acondicionado Archivo	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	25/01/2024	25/02/2024	*											MANT-CORRECTIVO	
Equipos tecnologicos. Archivo	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024													
Equipos tecnologicos. Archivo. Fac	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024													
Equipos tecnologicos. Oficina RRHH	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024													
Equipos tecnologicos. Contabilidad	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024													
Equipos tecnologicos. Amd. Secre.	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024													
Impresora Oficina Amd	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/07/2023	15/02/2024													
Aire Acondicionado AMD.	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	25/01/2024	25/07/2024	*											chequeo preventivo	
Aire Acondicionado Direccion	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	15/02/2024													
Equipos tecnologicos Direccion	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	15/02/2024													
Impresora Oficina Direccion	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	15/02/2024													
Maquina de anestesia. Cirugia	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	trimestral	15/12/2023	15/03/2024													
Abanico Productos de limpieza	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/10/2023	15/04/2024													
Abanico Despensa	mantenimiento preventivo	mantenimiento preventivo	correctivo y preventivo	Semestral	15/10/2023	15/04/2024													
Esterilizador en Cirugia	chequeo	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	20/02/2024													
Camillas de Cirugia	chequeo	chequeo	correctivo y preventivo	Semestral	15/08/2023	15/02/2024													

Dr. Alejo Martínez García  
Administración