

## Muestra de los mantenimientos realizados

### Marzo 2024

Mantenimiento preventivo a la red eléctrica.



Imagen tomada el 08/03/2024.

**Mantenimiento correctivo, esfigmomanómetro de pared.**



Imagen tomada el 14/03/2024.

## Limpeza general de aires acondicionados.



Imagen tomada el 13/03/2024.

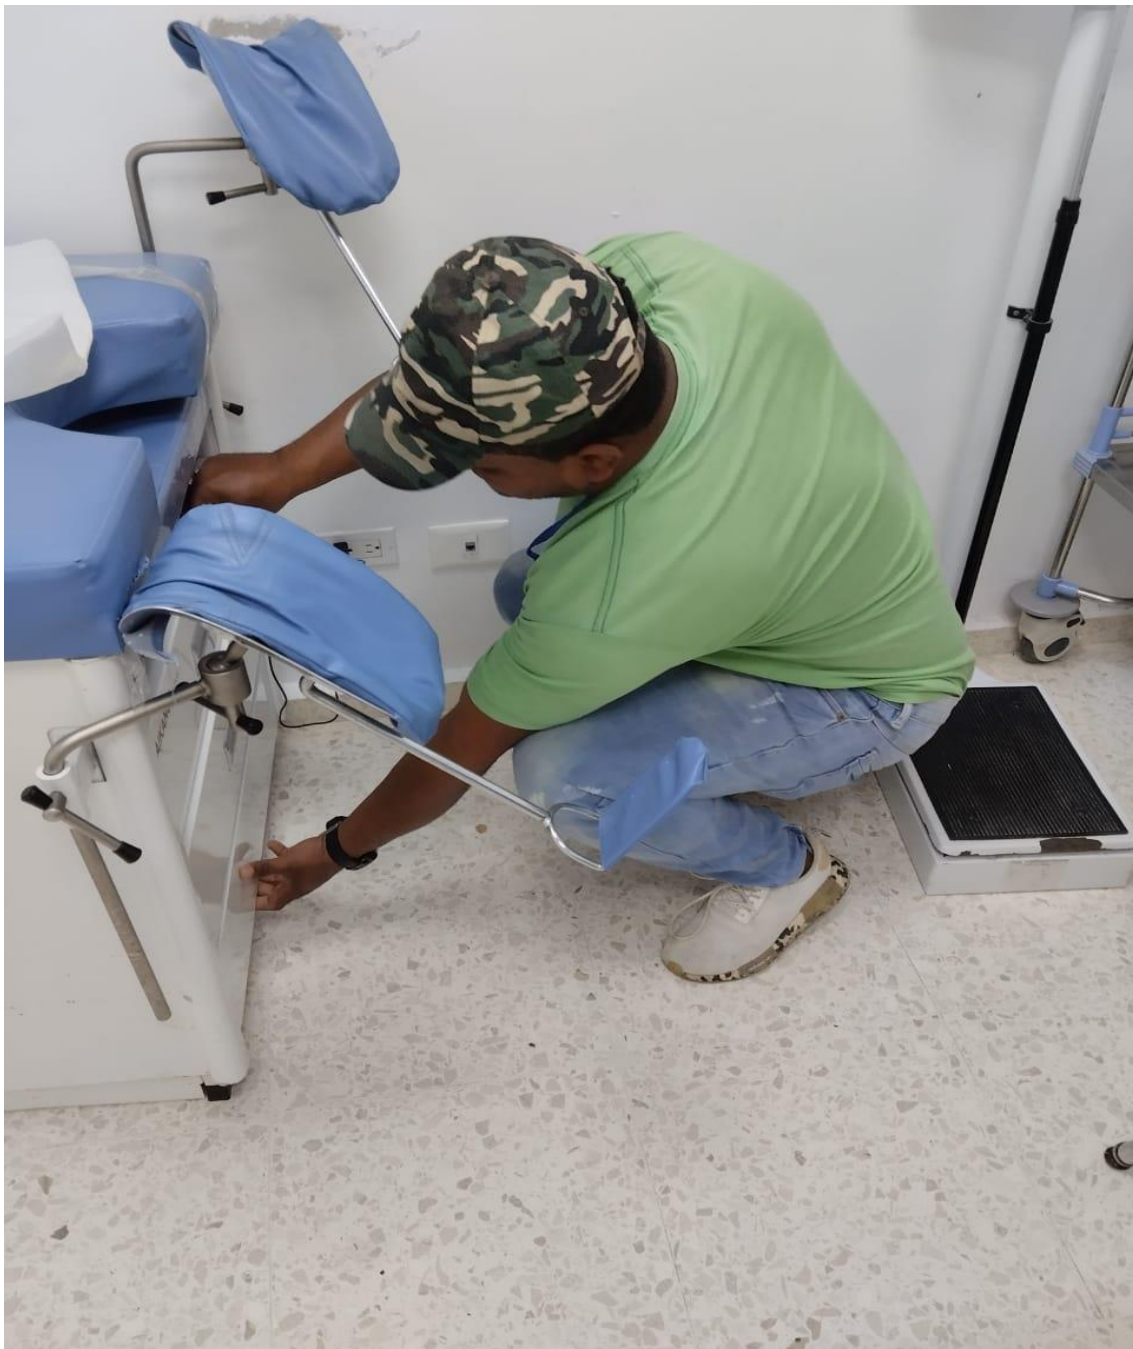
## Mantenimiento correctivo, carro de paro.



Imagen tomada el 15/03/2024.



**Mantenimiento preventivo de camilla ginecológica, chequeo continuo de todas las partes.**



**Imagen tomada el 11/03/2024.**

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	FECHA	8/03/24
NOMBRE DEL RESPONSABLE	EL VALLE	PROVINCIA	AZUA
	JAIRO RAMIREZ	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCIÓN

NOMBRE DEL EQUIPO	Neolético	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/>	Reparado	
AREA INTERVENIDA			

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

De electrica.  
Chequeo en general de  
Todos los cables  
cambio de Toma corrientes  
Todo en buen estado

OBSERVACIONES

*Jairo Ramirez*  
FIRMA RESPONSABLE





INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	FECHA	14/03/21
NOMBRE DEL RESPONSABLE	EL VALLE	PROVINCIA	AZUA
	JAIRO RAMIREZ	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	esfumador	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/>	Reparado	
AREA INTERVENIDA			

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Es fumador de gas  
en total 7.  
prueba de funcionamiento  
desinfección.  
chequeo de todas sus parte  
buen estado

OBSERVACIONES

  
FIRMA RESPONSABLE







Control de Calidad de Mantenimiento  
Preventivo de Equipos  
DLC-FO-013- Versión: 01  
Fecha de aprobación: 26.07.2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	FECHA	12/03/20
REGIONAL DE SALUD	EL VALLE	PROVINCIA	AZUA
NOMBRE DEL RESPONSABLE	JAIRO RAMIREZ	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	Aire acondicionado	TIPO O MODELO	A-203-4-2158
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/>	Reparado	
AREA INTERVENIDA			

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Aire acondicionado. Entregar un  
prueba de funcionamiento  
mantenimiento de todos  
los filtros y mantenimiento  
en Jexosa

OBSERVACIONES

  
FIRMA RESPONSABLE







Control de Calidad de Mantenimiento  
Preventivo de Equipos  
DLC-FO 013- Versión: 01  
Fecha de aprobación: 26/07/2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		FECHA	15/03/24
REGIONAL DE SALUD	EL VALLE	PROVINCIA	AZUA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	JAIRO RAMIREZ	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	


INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCIÓN

NOMBRE DEL EQUIPO	Carrro de parto	TIPO O MODELO	000.11/2211C
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/>	Reparado	
AREA INTERVENIDA			

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Carrro de parto  
L'in pieza . en general  
chequeo de todas sus parte  
Todo en buen estado

OBSERVACIONES

  
FIRMA RESPONSABLE





INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	FECHA	11/03/24
NOMBRE DEL RESPONSABLE	EL VALLE	PROVINCIA	AZUA
	JAIRO RAMIREZ	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO


INFORMACIONES DEL EQUIPO O ACTA DE INTERVENCIÓN

NOMBRE DEL EQUIPO	camilla sinecolosa	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/> Reparado <input type="checkbox"/>		
AREA INTERVENIDA			

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Camilla sinecolosa.  
Chequeo de Todas sus partes  
Limpiada en general  
y desinfección.  
Todo en buen estado

OBSERVACIONES

  
FIRMA RESPONSABLE



Instalación / Maquinaria  (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último	Próximo	Mes de Ejecución	Observaciones
					Mantenimiento	Mantenimiento	Mar	
Impresora Multifuncional en total 10	Parte externa, cartuchos, parte eléctrica.	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctricos y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	7/12/2023	7/3/2024	X	Todos estan en perfecta condiciones.
UPS 500 VA en total 29	Parte externa, baterías y conexiones eléctrica	Limpieza general, prueba de baterías, chequeo de partes eléctricas y prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	11/12/2023	11/3/2024	X	Todos estan bien excepto uno que tiene la bacteria dañada
Abanico de pared (02)	Parte Interna y externa	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Todos estan en perfecta condiciones.
Abanico pedestal en total 02	Parte Interna y externa	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Todos estan en perfecta condiciones.
Abanico de techos en total 05	Parte Interna y externa	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	05/0.3/2024	X	Todos estan en perfecta condiciones.
Aspirador quirúrgico en total 04 unidades	Parte externa	Revisión general, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Estan bueno en uso.
Carro de parro	Parte interna e externa	Verificación general, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Mensual	4/12/2023	04/1/01/2024	X	Bueno en uso
Rotador	Parte interna y externa	Mantenimiento general, verificación de los controles de velocidad y verificación de la parte mecánica.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Bueno en uso
Equipo de química	Parte interna y externa	Mantenimiento general, Prueba de funcionamiento, chequeo, sistema óptico, chequeo filtros, chequeo lámpara, halógena.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Bueno en uso
Maquina de hemograma	Parte interna y externa	Mantenimiento general, comprobación de (status), calibración, lubricación de motor de jeringa y limpieza del sensor de jeringa Cojida de muestras.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Bueno en uso
Centrifuga, 01 unida	Parte interna y externa	Mantenimiento general, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Bueno en uso
Centrifuga de 32 tubo (01)	Parte interna y externa	Mantenimiento general, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso y calibración.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Bueno en uso
Compresor de Aire 01 unidad	Parte interna e externa	Calibración de presión, chequeo fuga de aire, calibración apagado y encendido automático.	Preventivo	Trimestral	14/12/2023	14/3/2024	X	Bueno en uso
Desfibrilador en total 03 unidades.	Parte interna y externa	Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, chequeo de la fuente de alimentación, ajuste, verificación de desfibrilación sincrónica, revisión kit baterías, Prueba del cable	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024	X	Bueno en uso



		eléctrico, prueba de funcionamiento.						
Electrobisturi 01 unidad	Parte externa	Limpieza general, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024	X	Bueno en uso
Electrocardiografo en total 04 unidades	Parte externa	Mantenimiento general, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024	X	Bueno en uso
Electrocauterio 02 unidades	Cable electrico y conexiones	Verificacion de los cable electrico y de los conectores.	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024	X	Bueno en uso
Equipo de Rayos x (01)	Parte electrica, parte mecanica y maquina reveladora	Chequeo del interruptor general de la reveladora poniéndose en posición "OFF". Quitar la tapa y los paneles laterales de la reveladora, chequeo del interruptor de disparo, verificación línea de tensión, limpieza general y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Bueno en uso
Esfipmomanometro de pared (07)	Parte externa.	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	14/12/2023	14/1/2024	X	En la actualidad hay que cambiar tres efimos
Esfipmomanometro pedestal (03)	Parte externa.	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	12/12/2023	13/1/2024	X	Bueno en uso
Horno esterilizador mediano, 01 unidad	parte externa	Cheque de conexiones electrica, limpieza general.	preventivo	Trimestral	No se le ha dado mantenimiento	3/3/2024	X	El equipo aun no esta funcionando
Incubadora (04)	Parte externa e interna	Revisión y ajuste de temperatura, Revisión y cambio de filtro bacteriológico, Verificación de alarmas, Calibración general Y Limpieza general.	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024	X	Bueno en uso
Lampara cuello de ganzo (06)	Parte electrica y bombilla	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	4/12/2023	4/1/2024	X	Bueno en uso
Cuna de color radiante	Parte externa	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	4/12/2023	4/3/2024	X	Bueno en uso
Lampara de fototerapia (02)	Parte electrica	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento	Preventivo	Mensual	4/12/2023	4/1/2024	X	Bueno en uso
Lampara Quirurgica Movil (01)	Parte electrica y bacteria	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de bacteria y prueba de funcionamiento	Preventivo	Mensual	12/12/2023	12/1/2024	X	Bueno en uso
Lampara quirurgica dos satelites (02)	Parte electrica	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Mensual	12/12/2023	12/1/2024	X	Bueno en uso
Mescladora de tubo (01)	parte externa y electrica	Mantenimiento eléctrico, engrase y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Bueno en uso
Lavadora industrial (01)	Parte interna y externa	Chequeo de conductos de agua, verificación de las correas, verificación de la parte electrica, limpieza general y prueba de funcionamiento	Preventivo/ Correctivo	Mensual	No se le ha dado mantenimiento		X	Aun no esta funcionando, se esta preparando la estrura para proceder a montarla
Microscopios en total 03 unidades	Parte externa	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento..	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Bueno en uso

Monitor de signos vitales (12)	Parte externa	Cheque de bacteria, chequeo de partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024	X	Bueno en uso
Monitol fetal en total 02 unidades	Parte externa	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores	Preventivo	Trimestral	12/12/2023	12/3/2024	X	Bueno en uso
Nebulizador en total 05 unidades	Parte interna y externa	Limpieza del equipo, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones 0 ruido, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	1/12/2023	1/3/2024	X	Bueno en uso
Negatoscopio en total 15	Lamparas, interruptores y cables	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Preventivo	Trimestral	13/12/2023	13/3/2024	X	Bueno en uso
Otoscopio	Limpieza general	Limpieza y desinfeccion, cambio de baterias.	preventivo	Trimestral	13/12/2023	13/3/2024	X	Bueno en uso

Nevera en Total 06	Chequeo general	Matenemiento completo, verificar los cables y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	13/12/2023	13/2/2024	X	Bueno en uso
Sonografo en total 02	Parte Externa	Cheque de funcionamiento y limpieza.	Preventivo	Trimestral	13/12/2023	13/2/2024	X	Bueno en uso
Televisores en total 06	Parte externa	Chequeo de funcionamiento y limpieza.	Preventivo	Trimestral	13/12/2023	13/2/2024	X	Bueno en uso
Video colposcopio 01	Parte externa	Limpieza general y desinfección y cheque de partes eléctricas	Preventivo	Trimestral	5/12/2023	5/3/2024	X	Bueno en uso
Infraestructura	Pintura, techos, muros, parqueos y sotea.	Mantenimieto de pintura donde sea necesario, mantenimiento en la sotea, señalizacion de los parqueos, aceras y contenes, red electrica etc	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	10/12/2023	10/3/2024	X	En el mantenimiento a la infraestructura se reconstruyo las aceras y contenes, se le dio mantenimiento al techo y estamos a la espera de la disponibilidad del pintor, para pintar.
Pisos generales	Pisos de marmol, piso de ceramica y terraza.	Mantenimiento general, y correccion si hay fallas	Preventivo/ Correctivo	Diario	Diario		X	Bueno en uso
Moviliario oficinas y consultorios	Escritorios, Sillones, Bancos, Archivo y Estanteria	Apriete de tornillos y ajuste.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	5/12/2023	5/1/2024	X	Este tipo de mantenimiento tenemos que ejecutalo a diario, ya que siempre los equipos de oficina requieren de una supervision continua
Malla perimetral	Parte interna y externa	Limpieza, poda de arboles y reparacion	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	1/12/2023	1/3/2024	X	Se procedio a limpiar todas las maleas que le cubre, pero la misma se encuentra en mal estado.
Jardineria	Arboles, jardines frontal y later	poda de arboles, poda de los jardines y fumigacion.	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	1/12/2023	1/3/2024	X	todo en orden
Red electrica	Cuartos electricos, UPS Industrial, Toma corrietes, Lamparas de iluminacion, Tubos fluorescentes, Bombillos Interruptores y breaker.	Verificacion de todas las lamparas y bombillas, y reemplazarlo si alguna se encuentra dañada, verificacion de todos los toma corrientes e interruptores, verificacion de los Breaker, cheque de funcionamiento del UPS, verificacion de las bacterias del UPS.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	11/12/2023	11/12/2024	X	En este mes se le dio mantenimiento genertal.
Planta electrica	Al motor, Bateria, al radiador Motor de arranque.	Mantenimiento general, cambio de aceite, cambio de filtros aire, aceite y gasoil, chequeo de la bateria, verificacion del motor de arranque, verificacion del culan del radiador.	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	20/12/2023	20/3/2024	X	en este mes se le dio mantenimiento genertal